


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2015年製	管理番号	P008143
型式	VM76R	測定者	金子(拓)		

振り回し(300ピッチ)

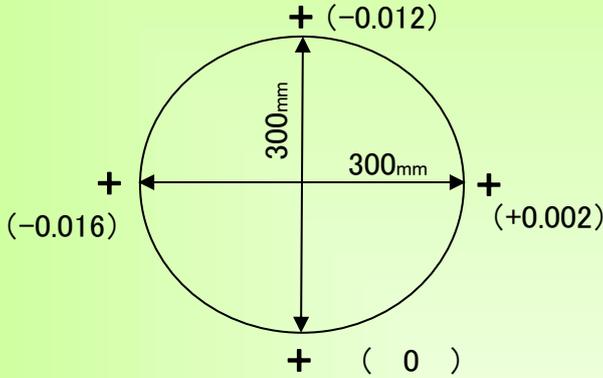

主軸振れ



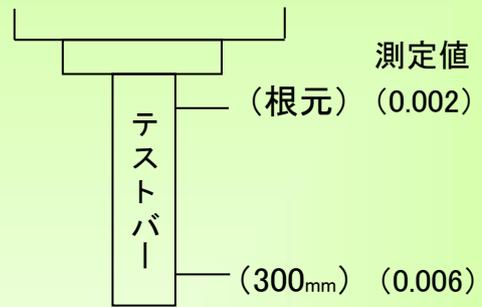


直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.012)

【XY】測定値 (0.006)

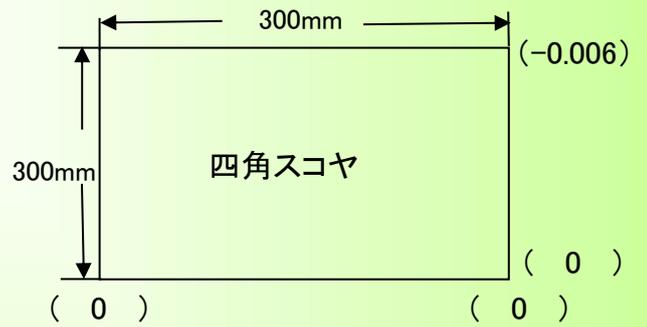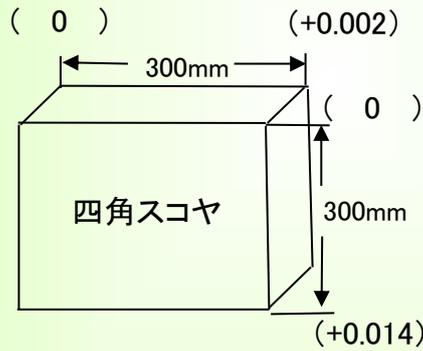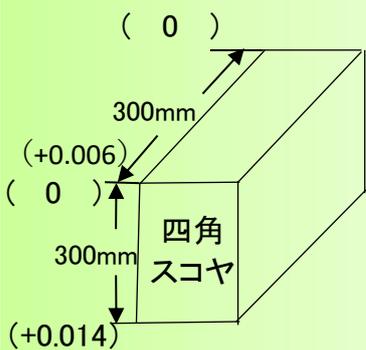

上面精度

※テーブルサイズ 1550×760

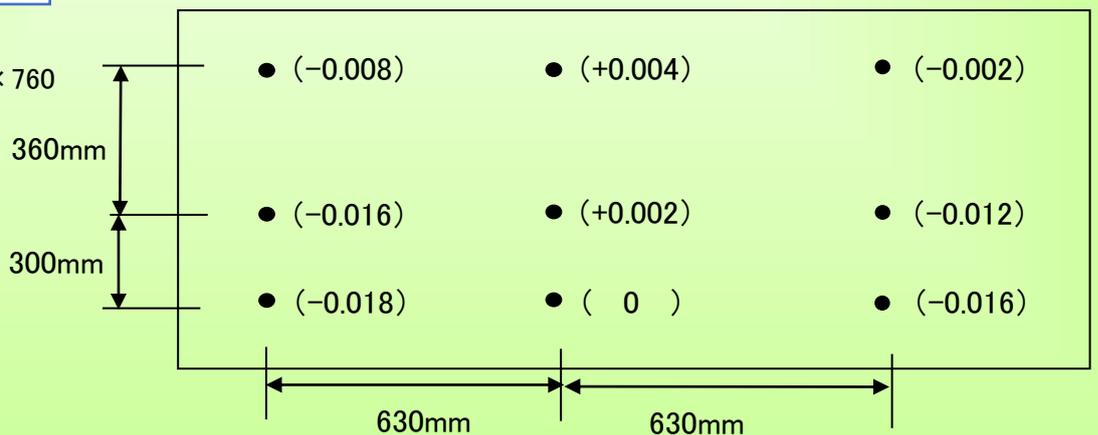

2023/3/16