


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ヤマザキマザック	年式	1999	管理番号	P008506
型式	MTV-515/40N	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

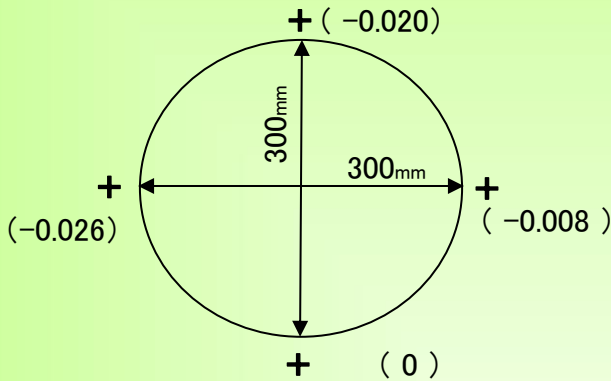

主軸振れ



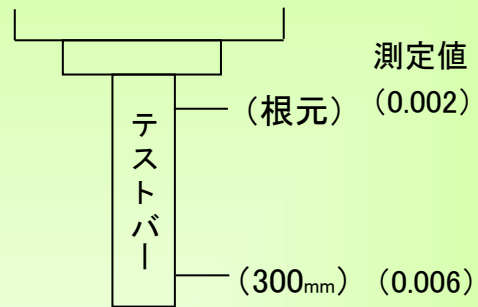


直角度

【YZ】測定値 (0.034)


【XZ】測定値 (0.020)

【XY】測定値 (0.010)

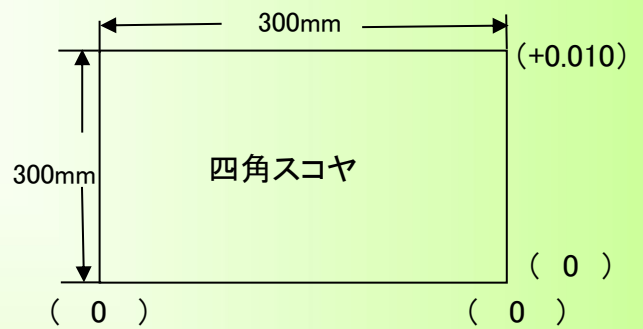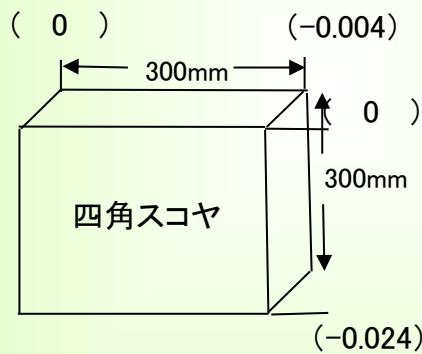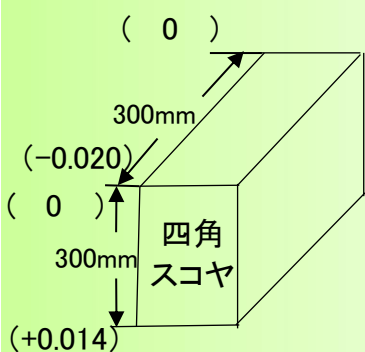

上面精度

※テーブルサイズ 1300×550

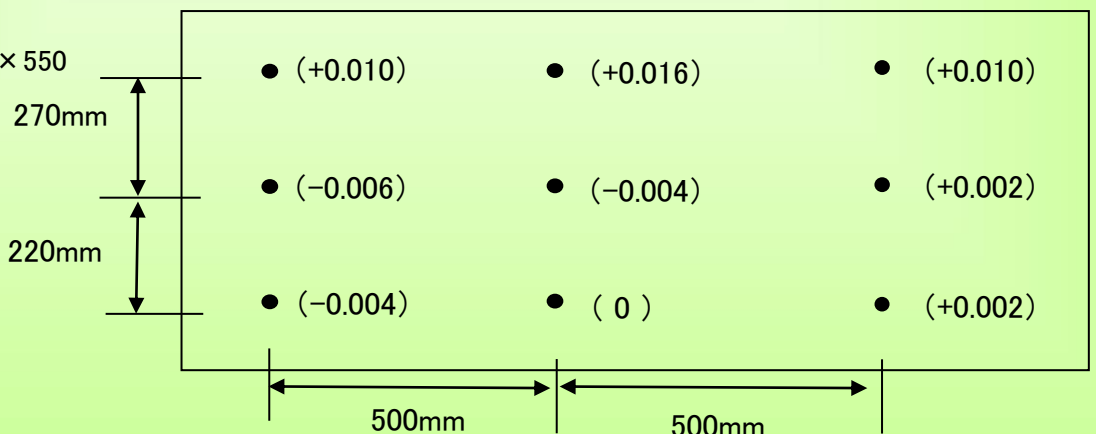

2024/4/26