


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	ファナック	年式	2004	管理番号	P008480
型式	$\alpha$ -T14iDL	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

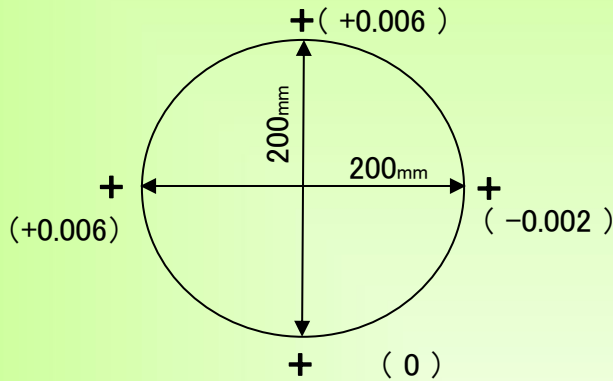

## 主軸振れ



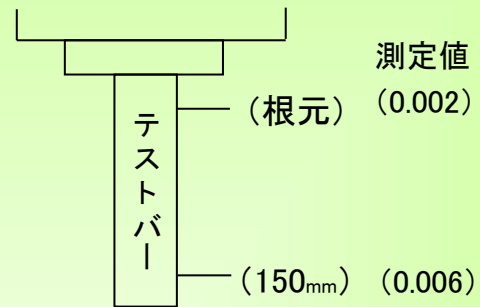


## 直角度

【YZ】 測定値 (0.006)


【XZ】 測定値 (0.008)

【XY】 測定値 (0.010)

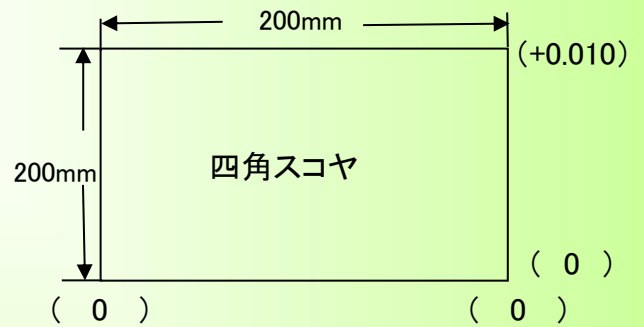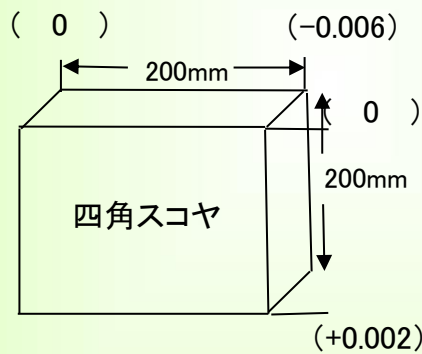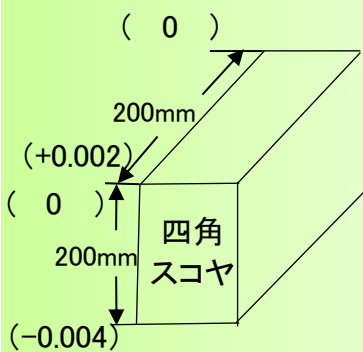

## 上面精度

※テーブルサイズ 850×410

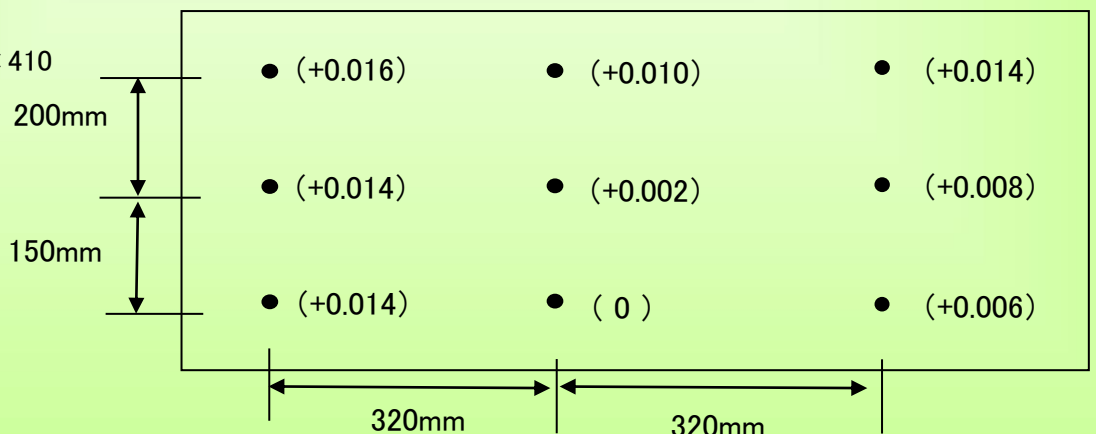

2024/4/25