


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2000	管理番号	P008487
型式	MX-45VA	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

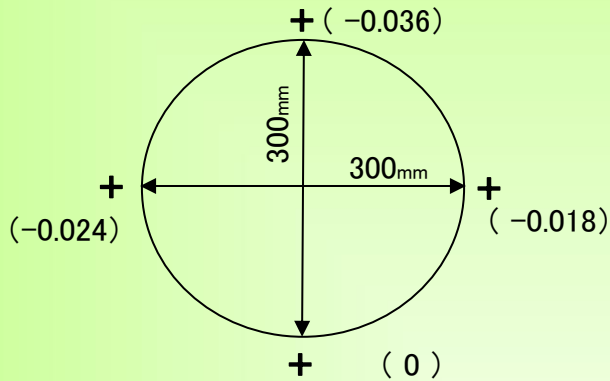

## 主軸振れ



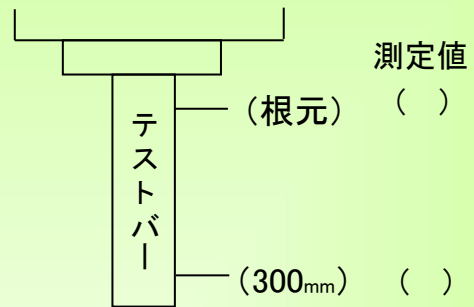


## 直角度

【YZ】測定値 (0.036)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.008)

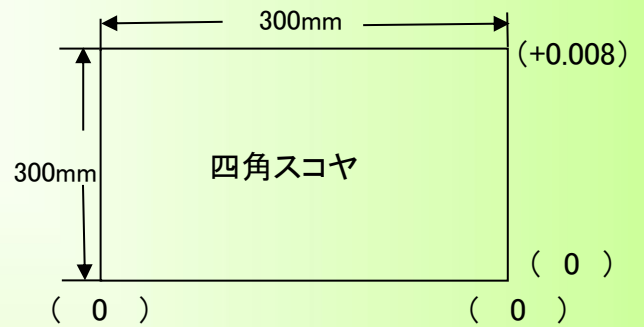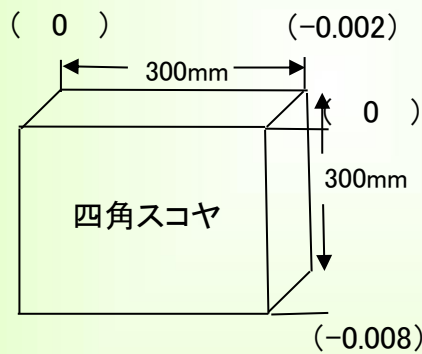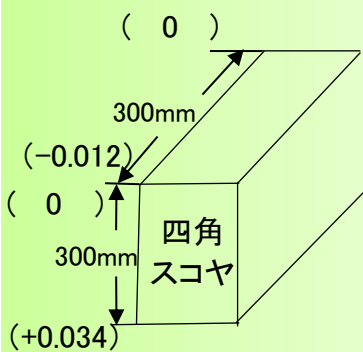

## 上面精度

※テーブルサイズ 760×460

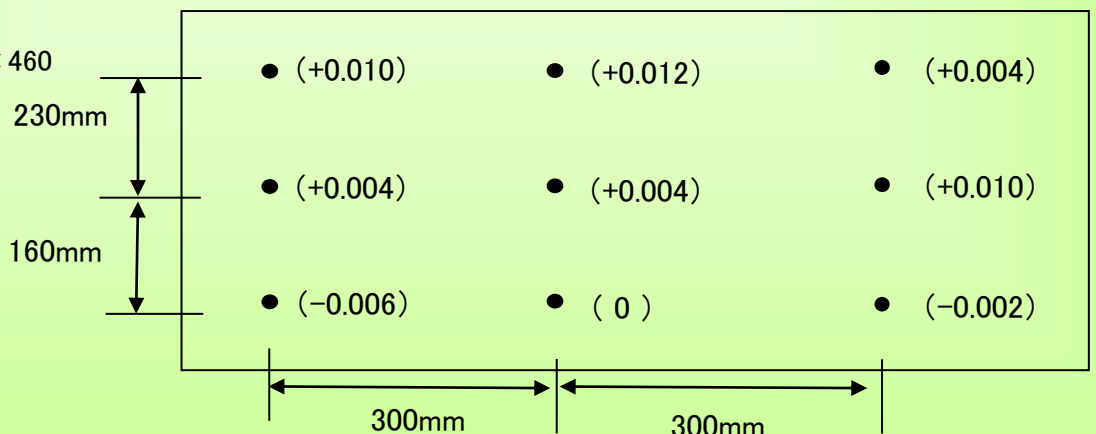

2024/5/2