


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	1999.3	管理番号	H016284
型式	RRM-3V	測定者	平野	アシスタント	

振り回し(ピッチ)

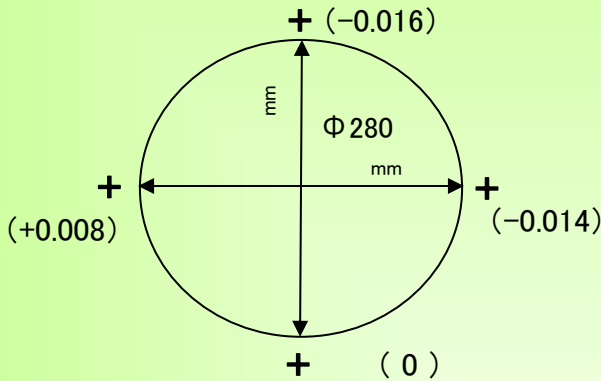

主軸振れ



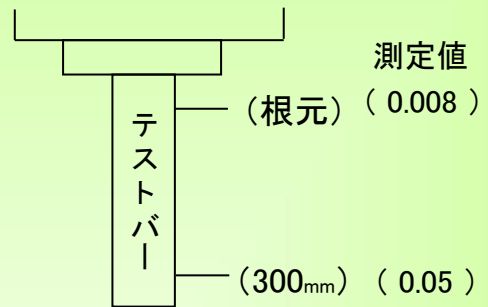


直角度

【YZ】測定値 (0.016)


【XZ】測定値 (0.02)

【XY】測定値 (0.02)

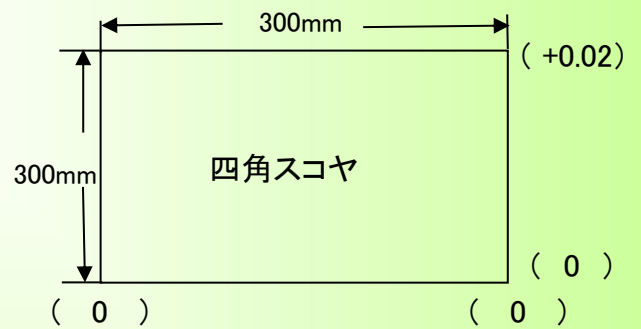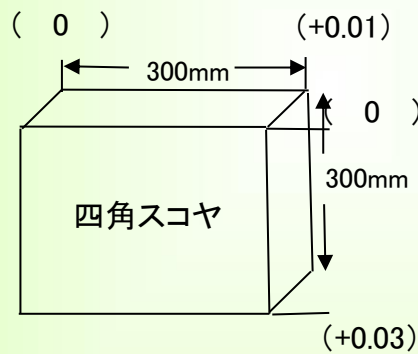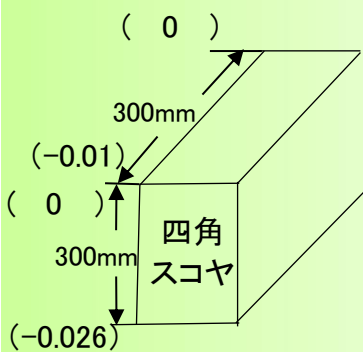

上面精度

※テーブルサイズ 1650×380

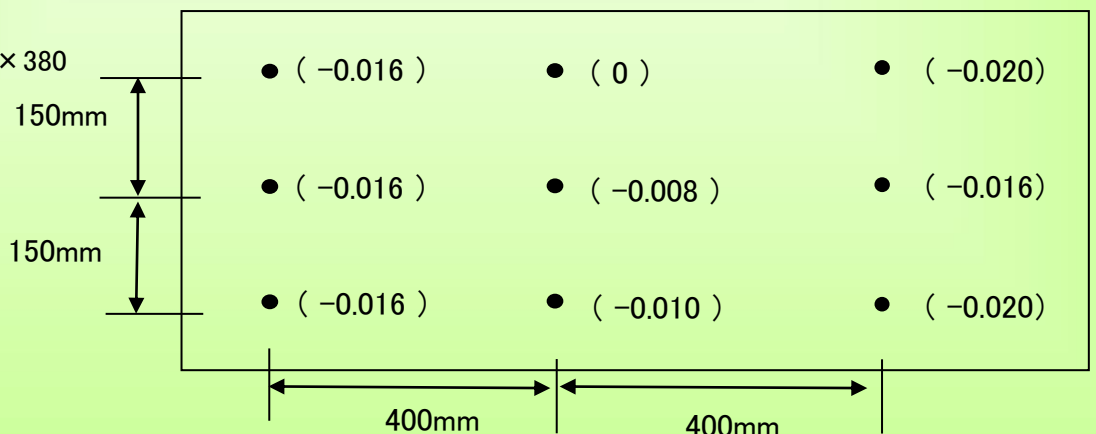

2024/6/14