


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2000.8	管理番号	H016149
型式	RRM-3V	測定者	平野	アシスタント	

振り回し(ピッチ)

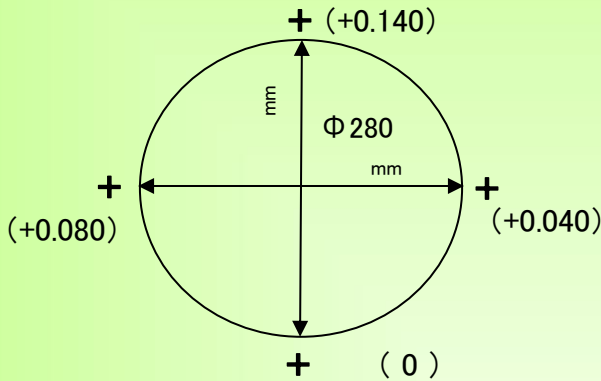

主軸振れ



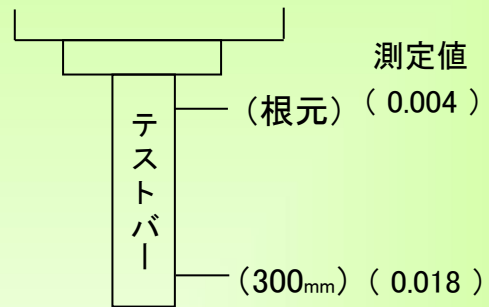


直角度

【YZ】 測定値 (0.02)


【XZ】 測定値 (0.014)

【XY】 測定値 (0.02)

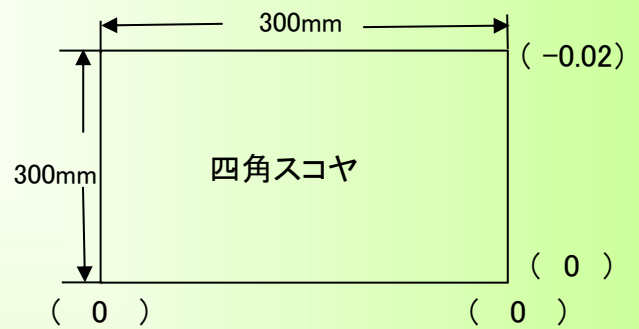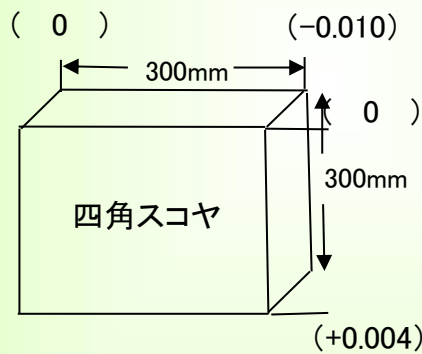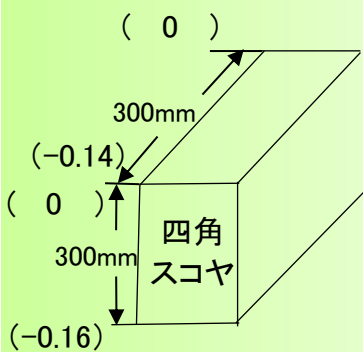

上面精度

※テーブルサイズ 1650 × 380

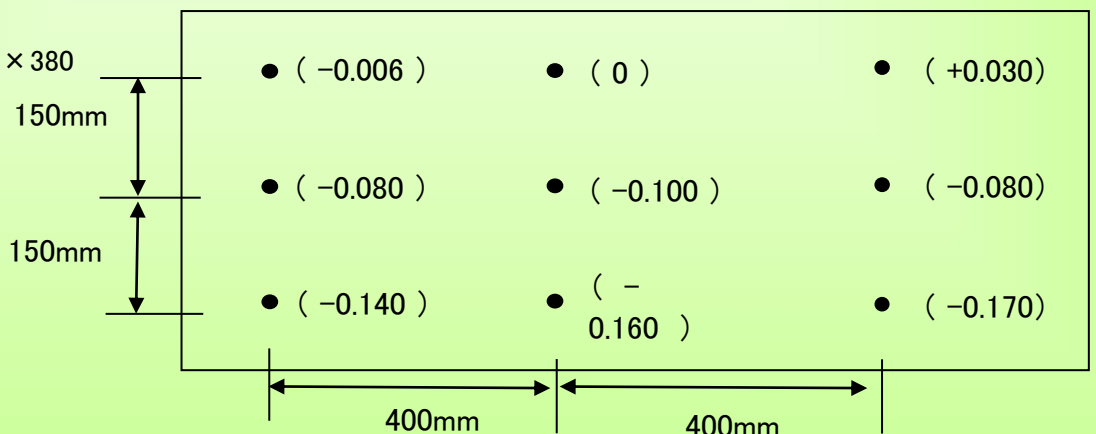

2024/6/14