


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式		管理番号	H016072
型式	MH-2P	測定者	山口	アシスタント	

Z軸方向の平行度

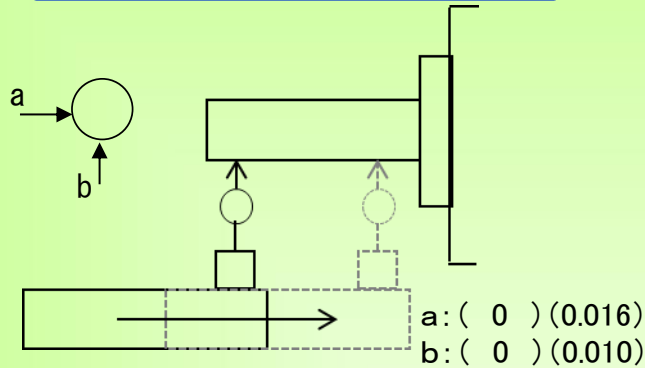

主軸振れ



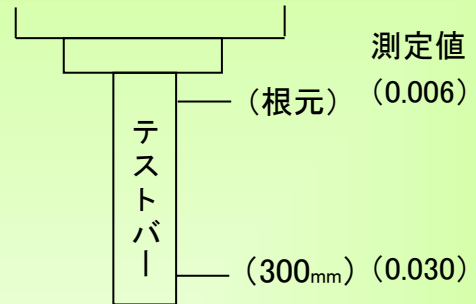


直角度


【XY】測定値 (0.006)

【ZY】測定値 (0.016)

【ZX】測定値 (0.018)

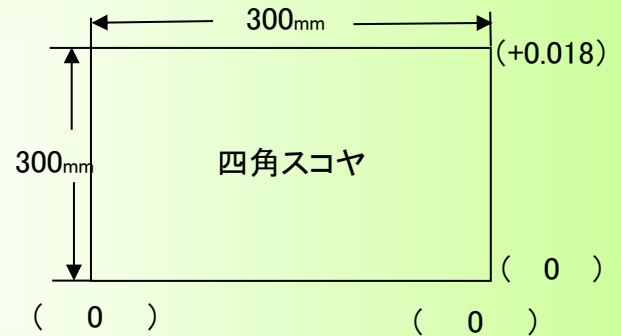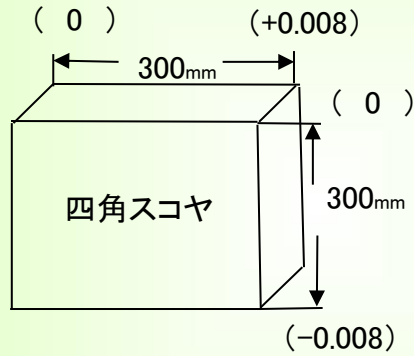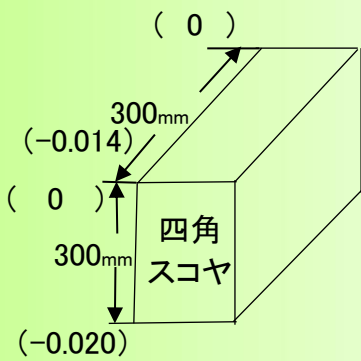

上面精度

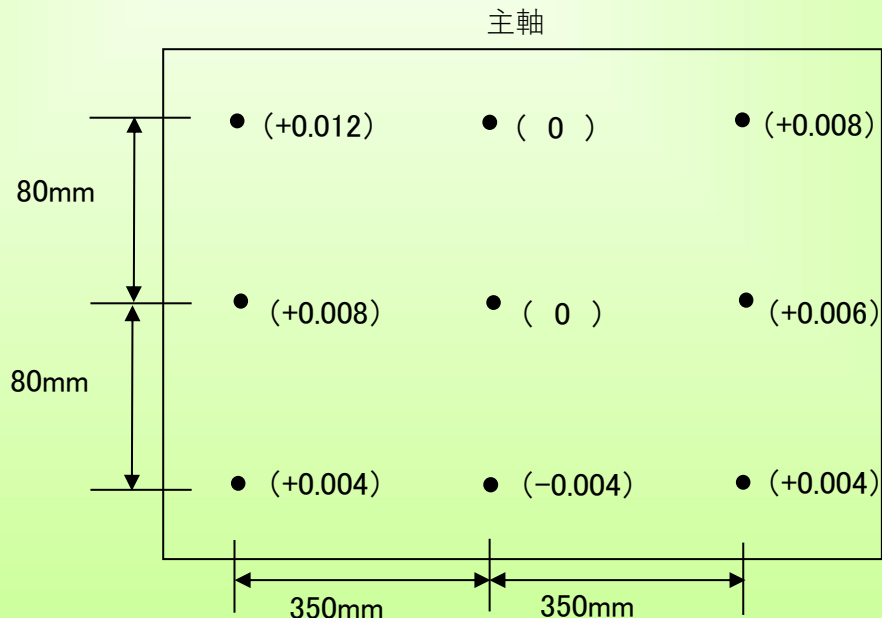

2024/6/14