


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

|      |           |     |      |        |         |
|------|-----------|-----|------|--------|---------|
| メーカー | 牧野フライス製作所 | 年式  | 2018 | 管理番号   | P008548 |
| 型式   | a40C2     | 測定者 | 金子   | アシスタント |         |

## Z軸方向の平行度

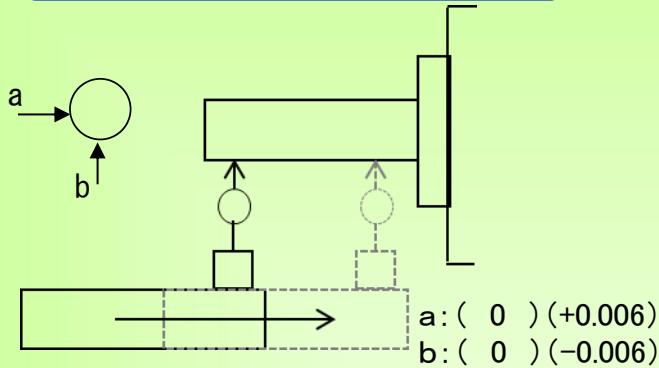

## 主軸振れ



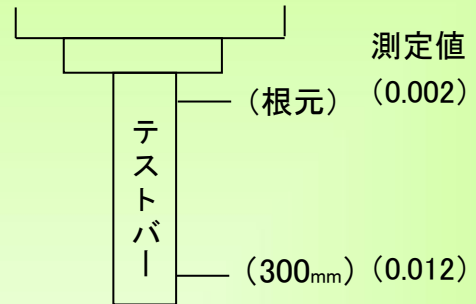


## 直角度

【XY】 測定値 (0.004)

【ZY】 測定値 (-0.004)


【ZX】 測定値 (0.002)

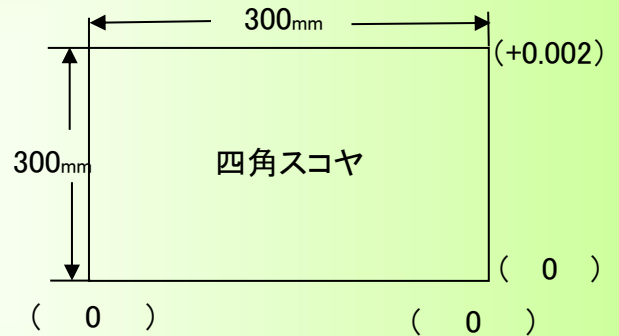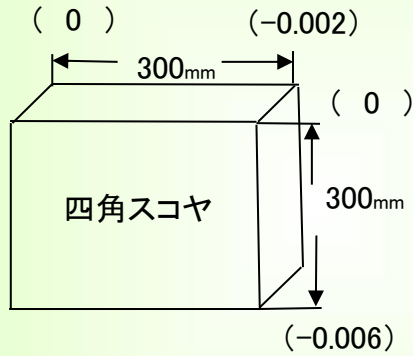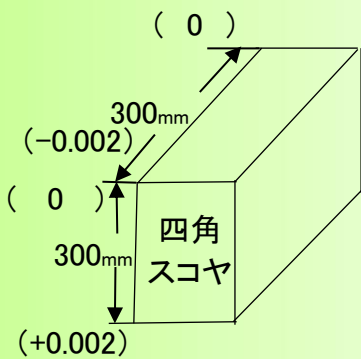

## 上面精度

テーブルサイズ: 400角

( )パレット1  
[ ]パレット2

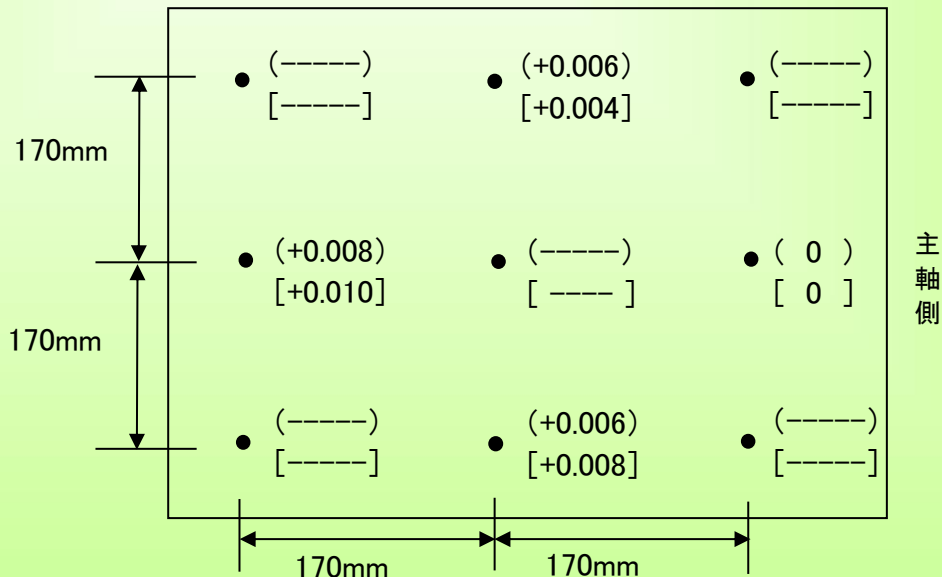

2024/6/17