


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2001.4	管理番号	P006726
型式	α -T14iBL	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

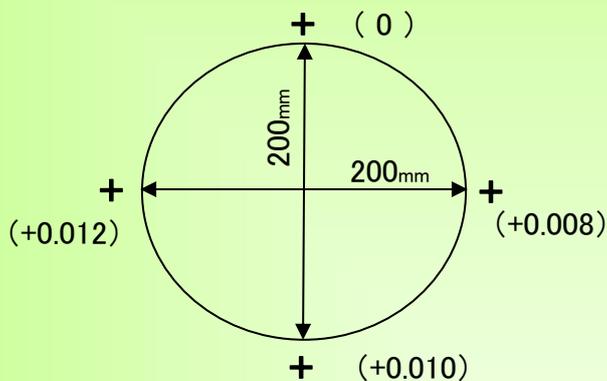

主軸振れ



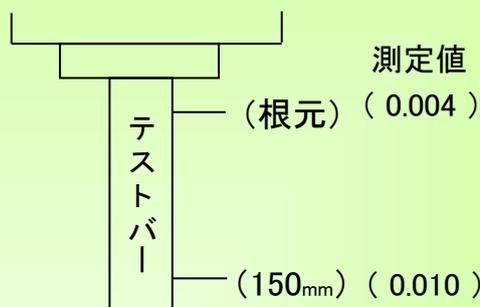


直角度

【YZ】測定値 (0.008)

【XZ】測定値 (-0.010)

【XY】測定値 (0.002)

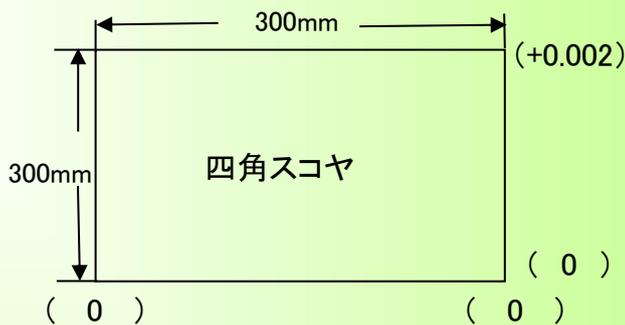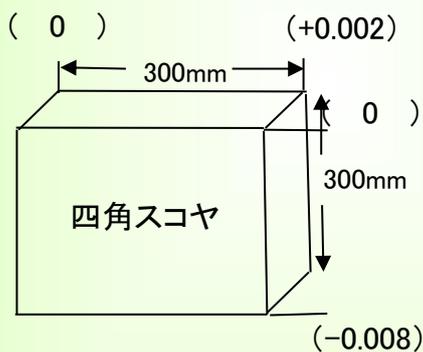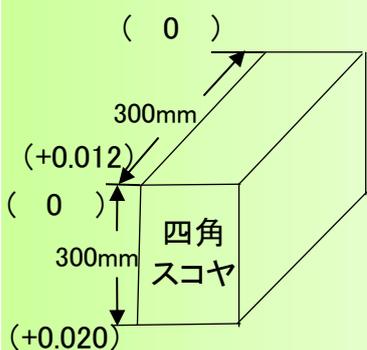


上面精度

※テーブルサイズ

850 × 410

150mm

150mm

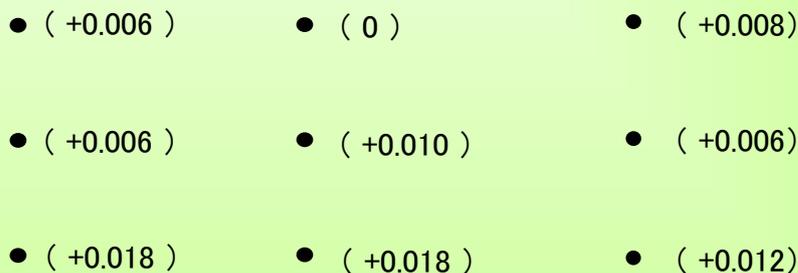

2024/6/14

300mm

300mm