


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2014	管理番号	P008562
型式	MILLAC-561V II	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

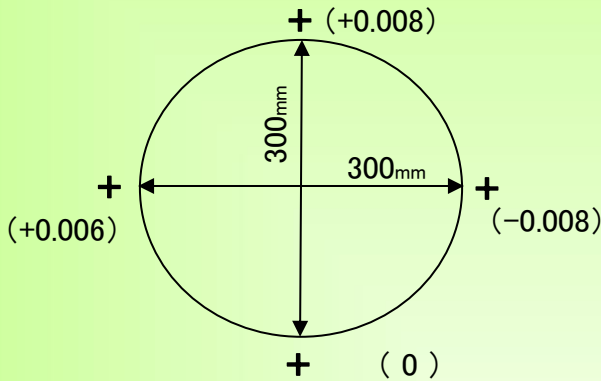

主軸振れ



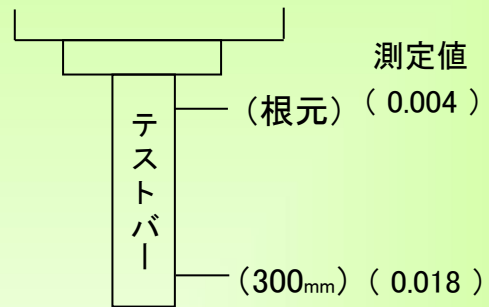


直角度

【YZ】測定値 (0.008)

【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.006)

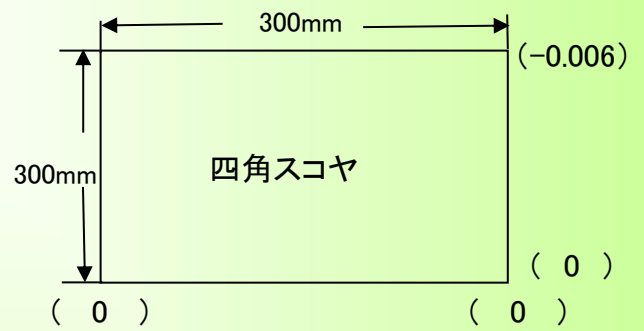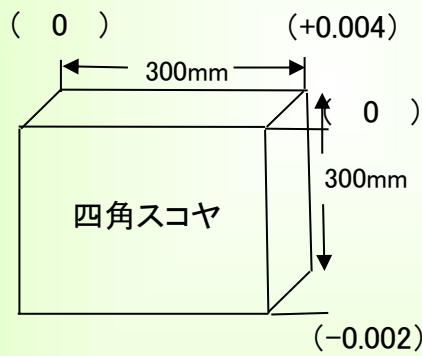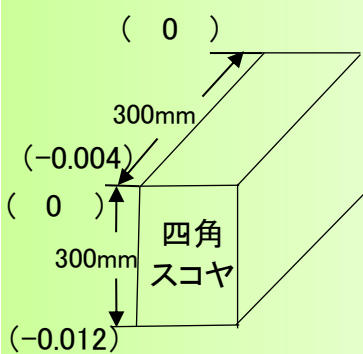


上面精度

※テーブルサイズ

1350 × 560

260mm

220mm

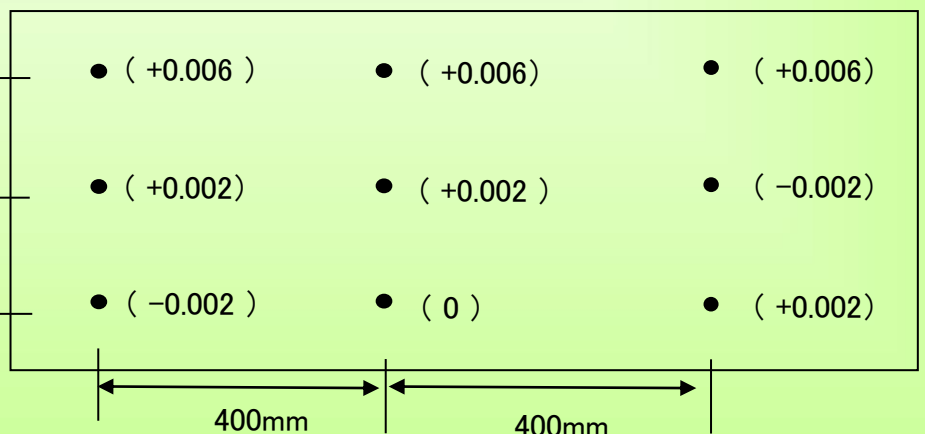

2024/6/25