


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2008	管理番号	P008535
型式	VM4III	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

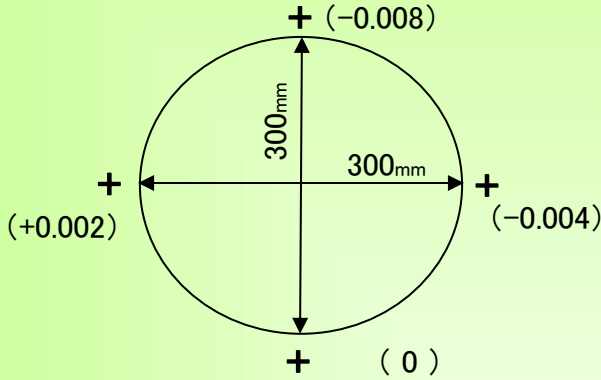

主軸振れ



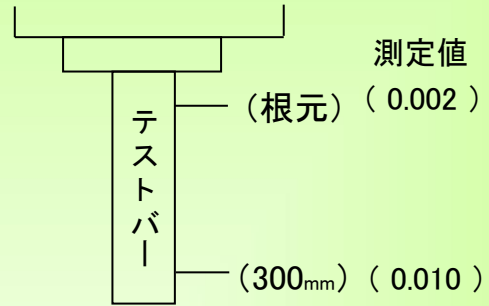


直角度

【YZ】測定値 (0.018)

【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.006)

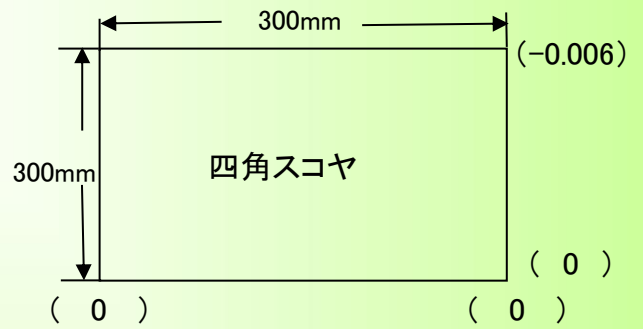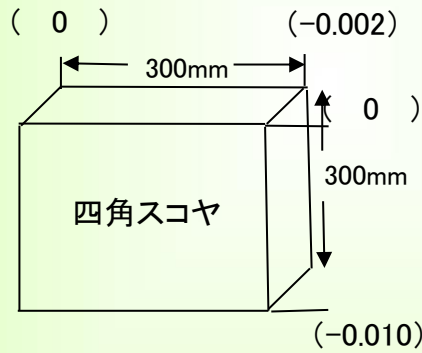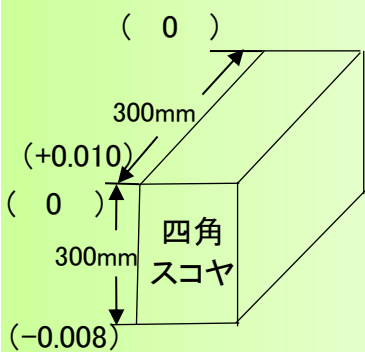

上面精度

※テーブルサイズ

800 × 410

200mm

150mm

● (-0.014)

● (-0.008)

● (-0.016)

● (-0.012)

● (-0.004)

● (-0.014)

● (-0.008)

● (0)

● (-0.016)

340mm

340mm

2024/6/21