


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2007	管理番号	P008555
型式	NV5000 α 1A/40	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

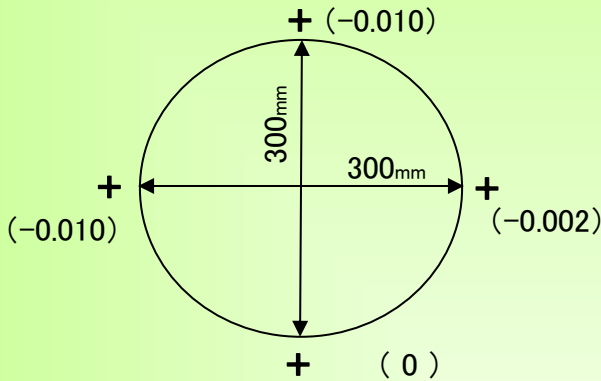

## 主軸振れ



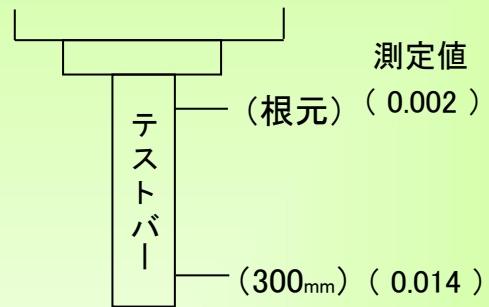


## 直角度

【YZ】 測定値 (0.008)

【XZ】 測定値 (0.018)

【XY】 測定値 (0.008)

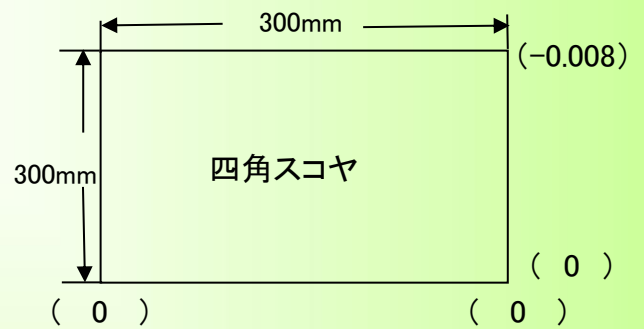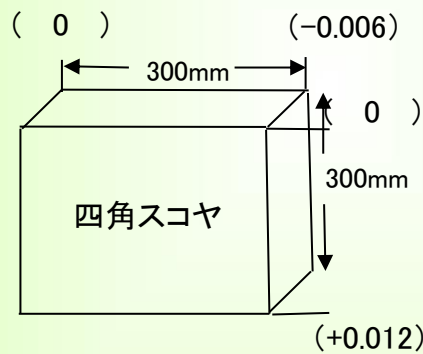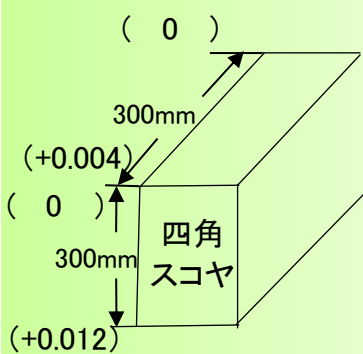

## 上面精度

※テーブルサイズ

1100 × 600

220mm

220mm

● (+0.002)

● (-0.008)

● (-0.012)

● (-0.002)

● (-0.010)

● (-0.012)

● (+0.004)

● (0)

● (+0.002)

360mm

360mm

2024/7/9