


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2008	管理番号	P008597
型式	$\alpha$ -T21iF	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(200ピッチ)

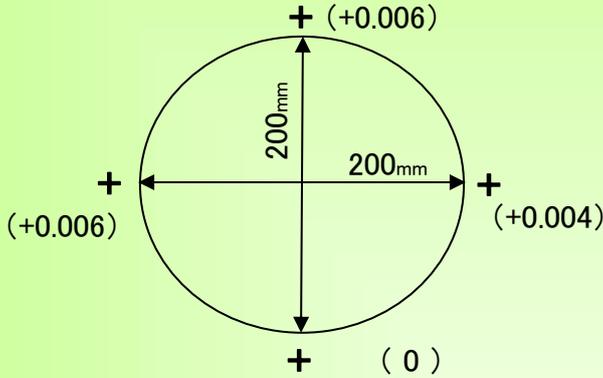

## 主軸振れ



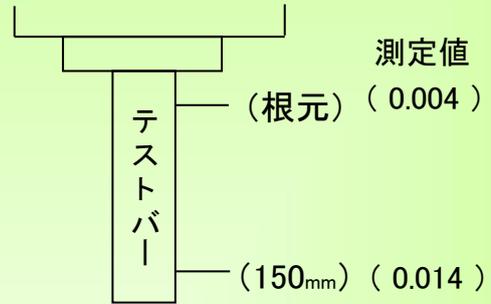


## 直角度

【YZ】測定値 (0.006)

【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.010)

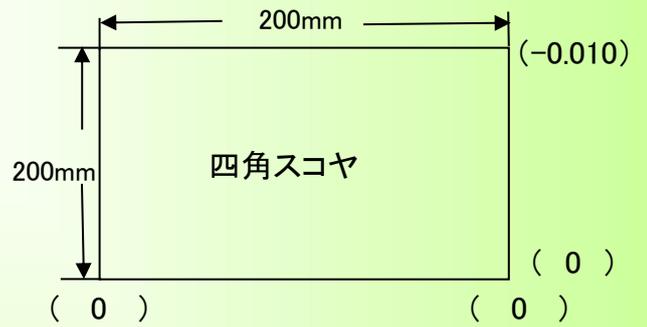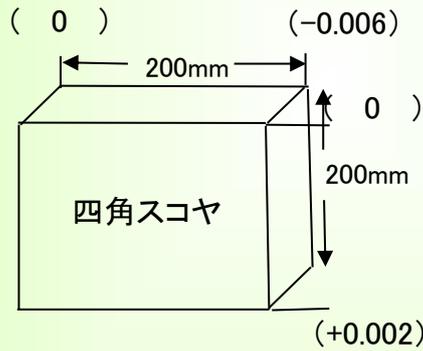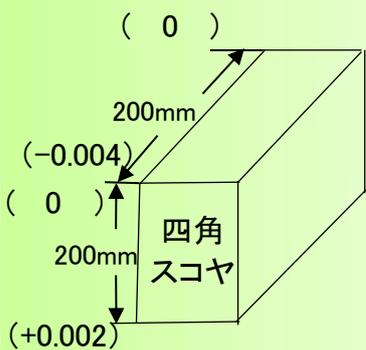

## 上面精度

※テーブルサイズ

650 × 400

200mm

140mm

● (+0.004)

● (-0.004)

● (+0.002)

● (+0.004)

● (-0.002)

● (-0.006)

● (+0.004)

● (0)

● (-0.004)

220mm

220mm

2024/7/11