


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2006	管理番号	P008595
型式	α -T14iE	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

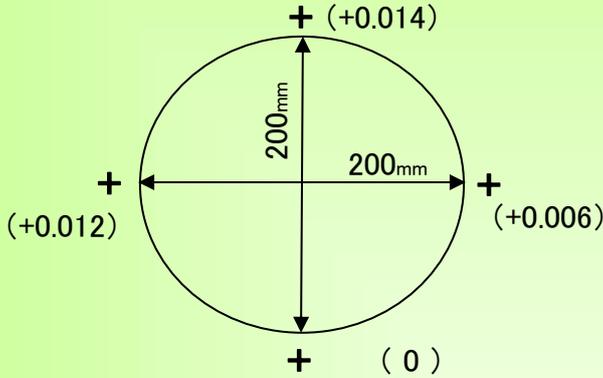

主軸振れ



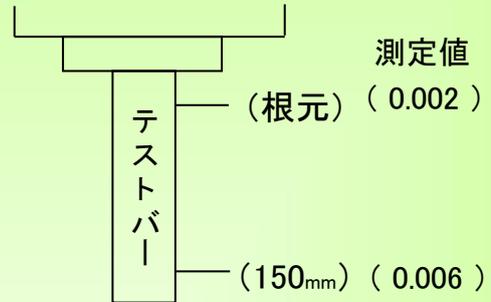


直角度

【YZ】測定値 (0.008)

【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.004)

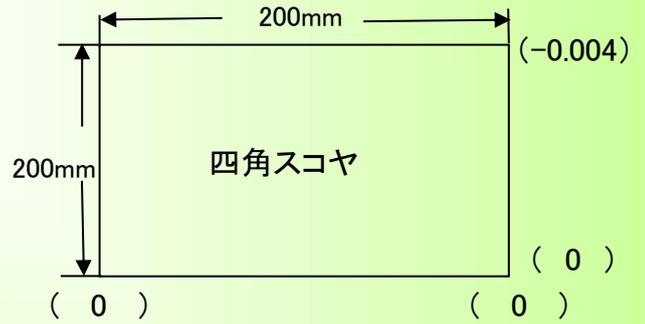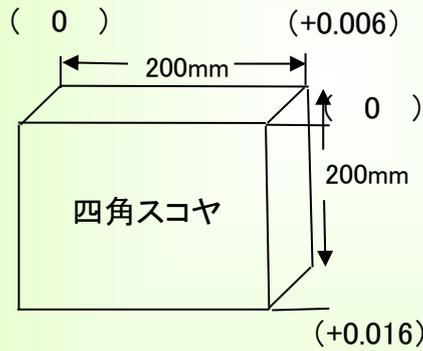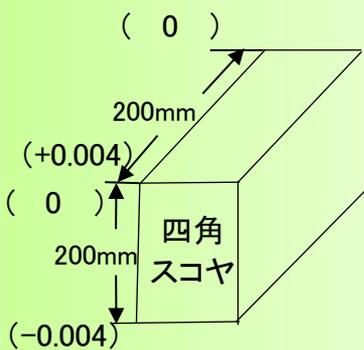


上面精度

※テーブルサイズ

650 × 400

200mm

140mm

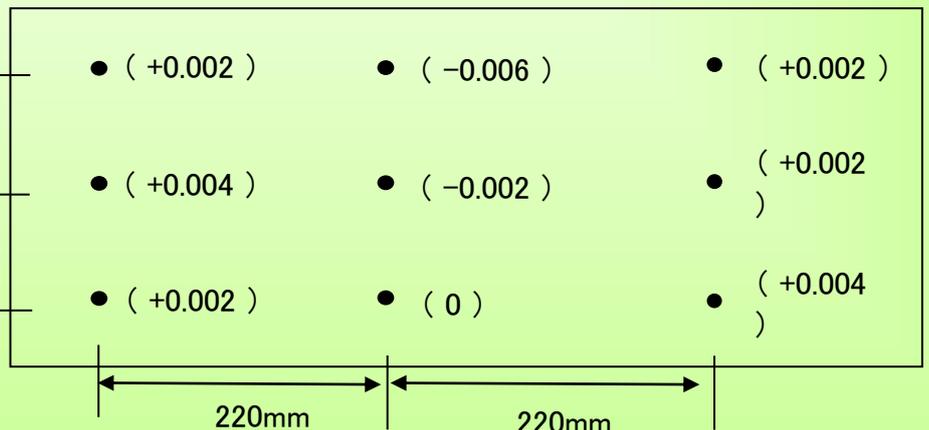

2024/7/11

220mm

220mm