


精度測定検査表

Examination for precision list


メーカー	ジェイテクト	年式	2012	管理番号	H018315
型式	SB3016	測定者	平野	アシスタント	

<室温33°C>

振り回し(300ピッチ)

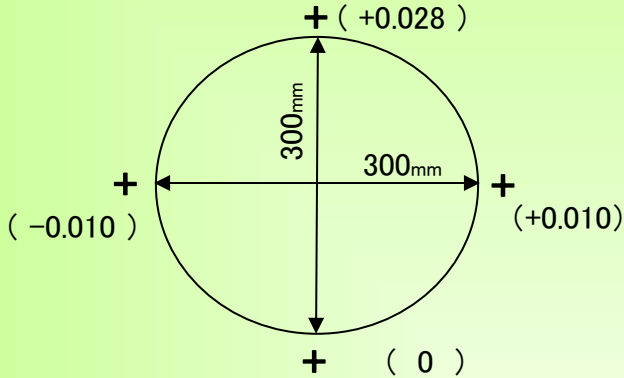

主軸振れ



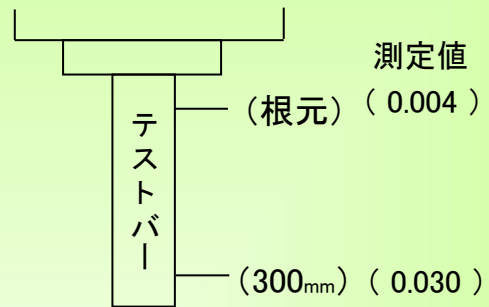


直角度

【YZ】測定値 (0.020)

【XZ】測定値 (0.020)

【XY】測定値 (0.020)

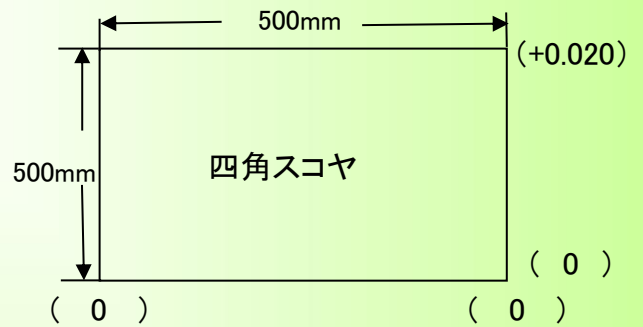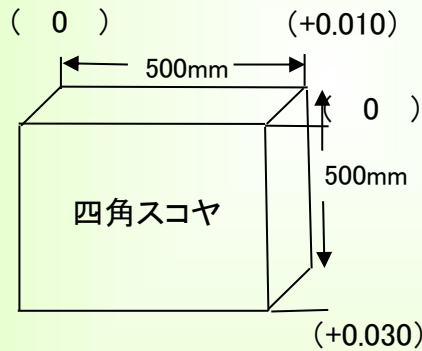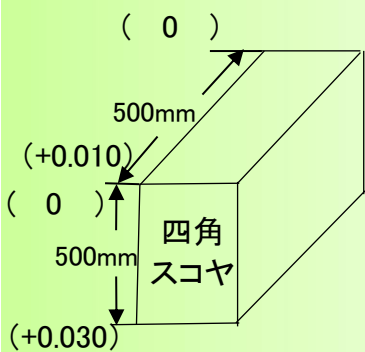

上面精度

※テーブルサイズ

【バックラッシュ測定】

X軸 0.002

Y軸 0.002


Z軸 0.002

補正(1851)

X3

Y1

Z1

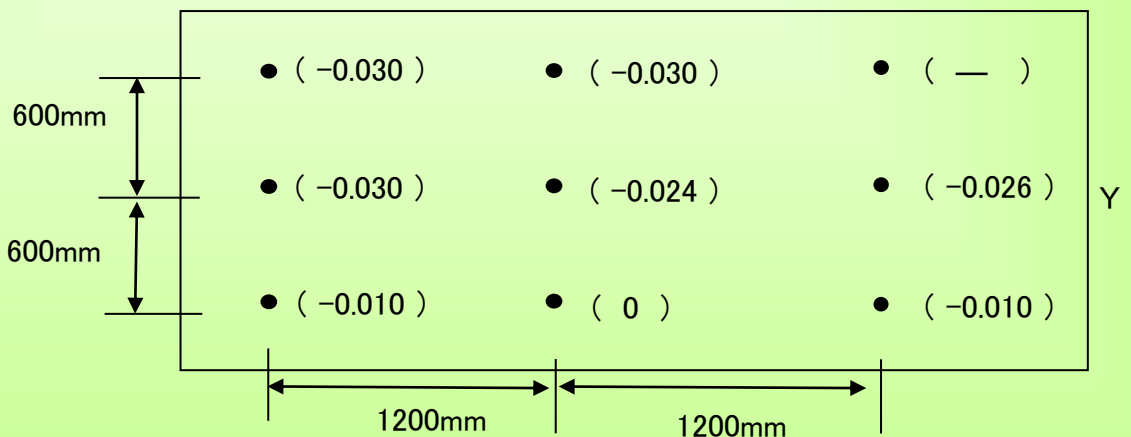

2024/7/23