


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2006	管理番号	P008587
型式	TC-S2B-0	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

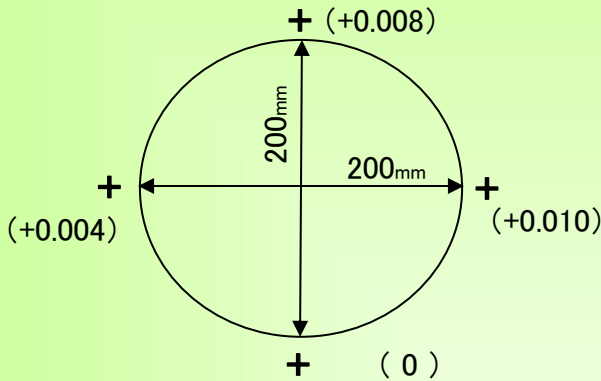

主軸振れ



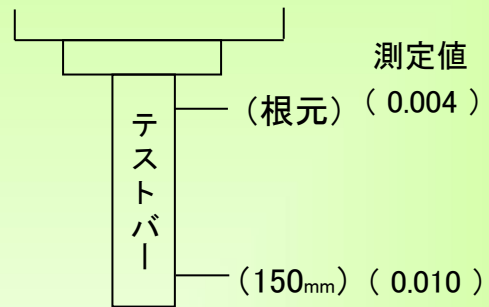


直角度

【YZ】測定値 (0.006)

【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.004)

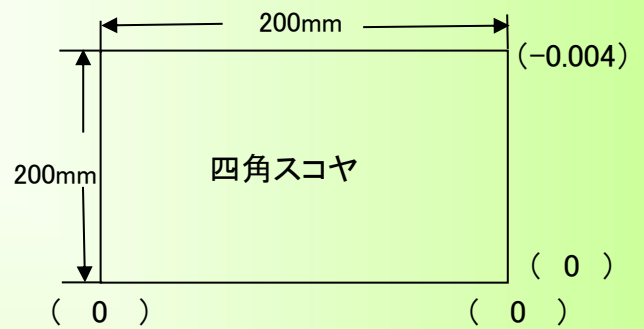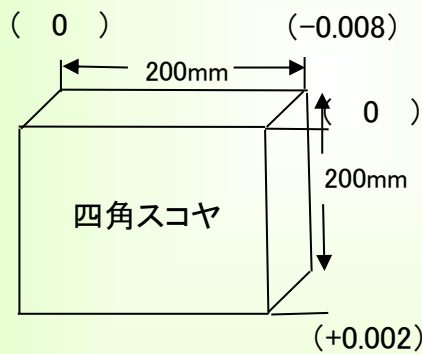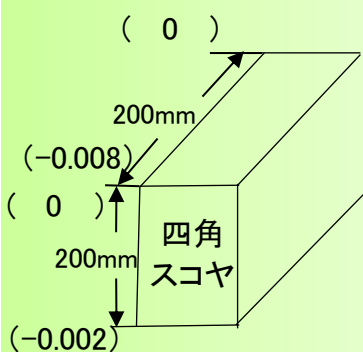


上面精度

※テーブルサイズ

800 × 320

150mm

120mm

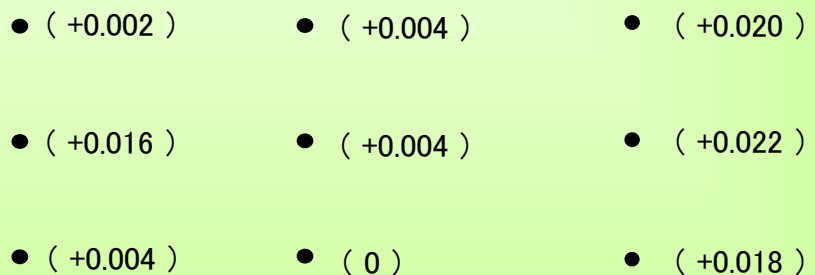

2024/7/19