


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2006	管理番号	P008519
型式	MB-56VA	測定者		アシスタント	

## 振り回し(200ピッチ)

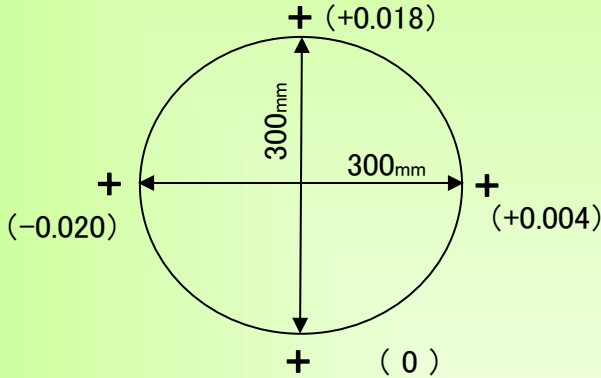

## 主軸振れ



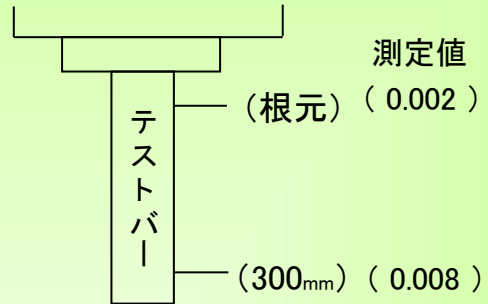


## 直角度

【YZ】測定値 (0.016)

【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.004)

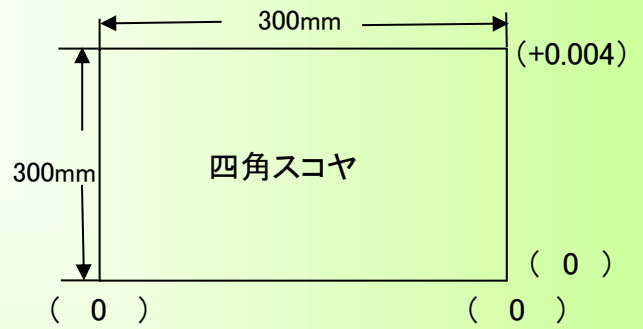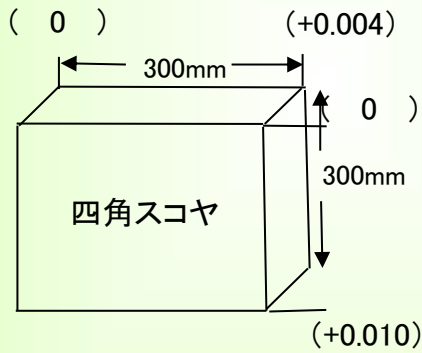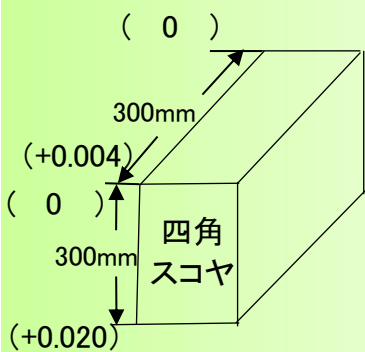

## 上面精度

※テーブルサイズ

1300 × 560

250mm

250mm

● (+0.030)

● (+0.012)

● (+0.024)

● (+0.018)

● (+0.010)

● (+0.024)

● (+0.004)

● (0)

● (+0.008)

420mm

420mm

2024/7/13