


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2006	管理番号	P008607
型式	$\alpha$ -T21iE	測定者	武藤	アシスタント	

## 振り回し(200ピッチ)

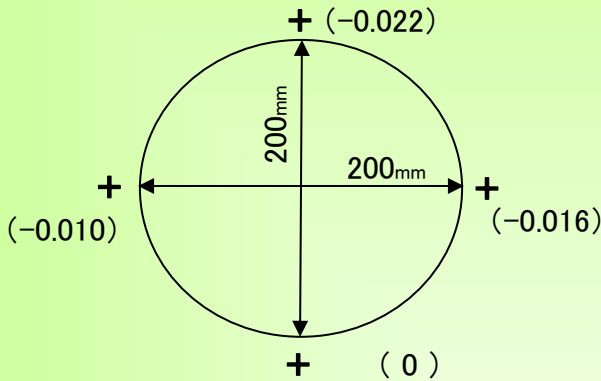

## 主軸振れ



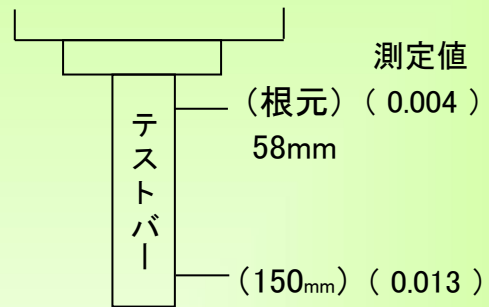


## 直角度

【YZ】測定値 (0.008)

【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.006)

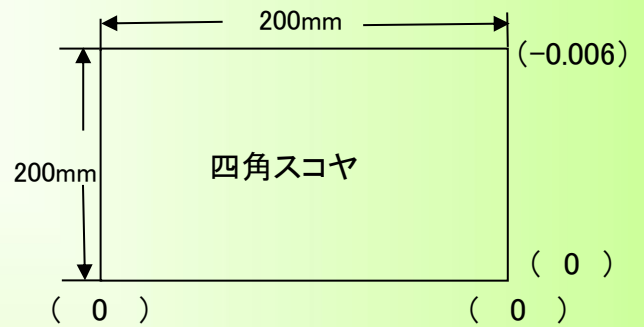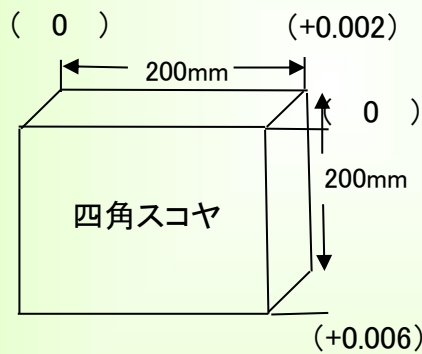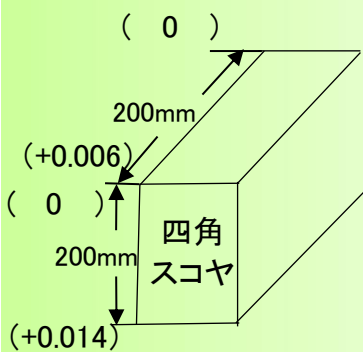


## 上面精度

※テーブルサイズ

650 × 400

200mm

150mm

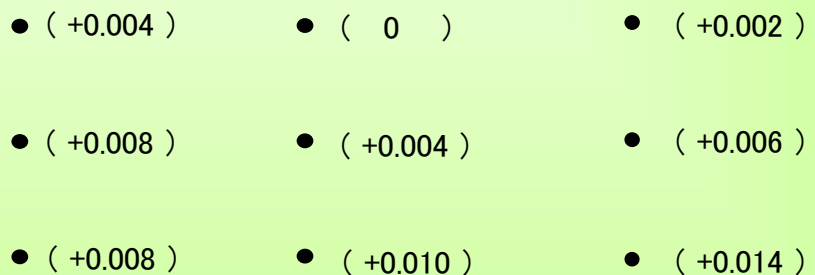

2024/8/27