


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	三井精機	年式	2006	管理番号	P008648
型式	J300G	測定者	野辺沼	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

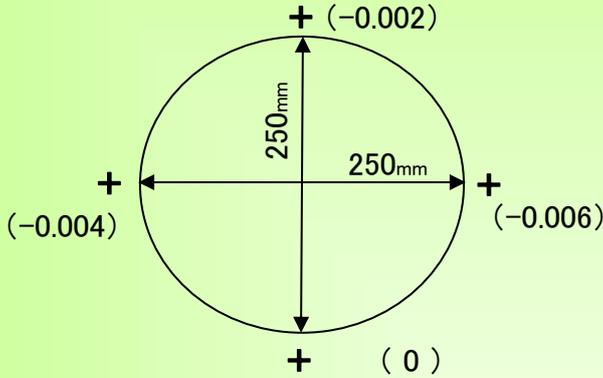

## 主軸振れ



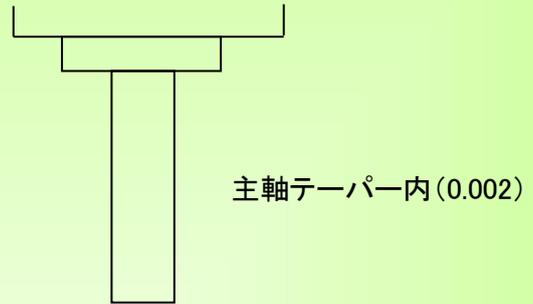


## 直角度

【YZ】測定値 (0.004)

【XZ】測定値 (0.002)

【XY】測定値 (0.004)

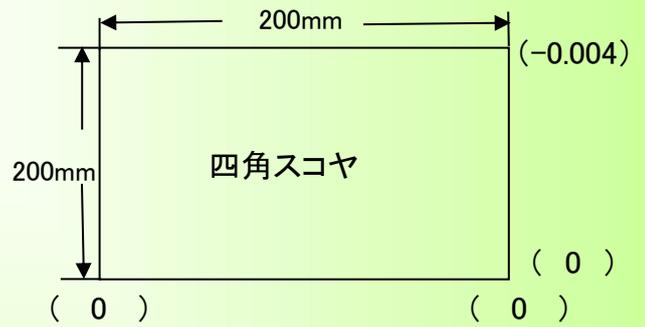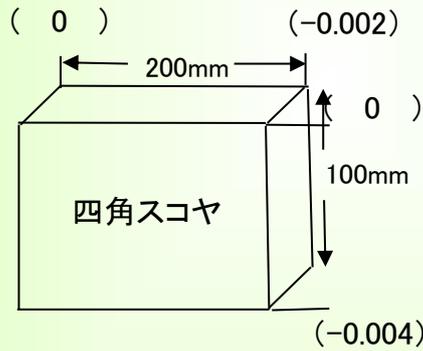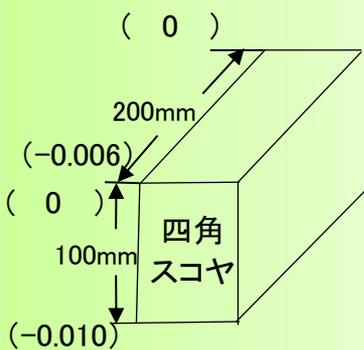


## 上面精度

※テーブルサイズ

700 × 290

130mm

130mm

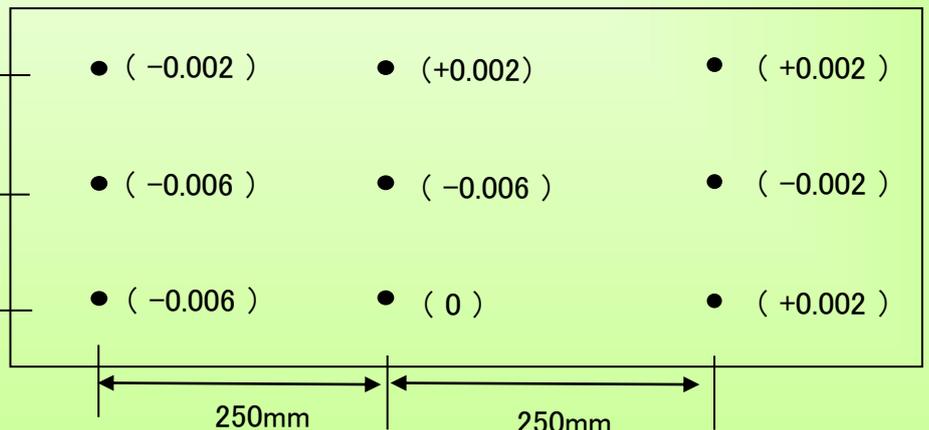

2024/9/10

1/2ページ



# 精度測定検査表

*Examination for precision list*

メーカー	三井精機	年式	2006	管理番号	P008648
型式	J300G	測定者	野辺沼	アシスタント	

【YW】測定値 (0.002)

【XW】測定値 (0.012)

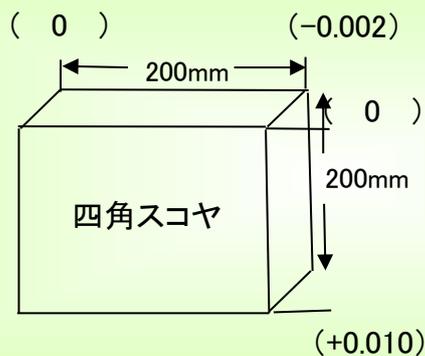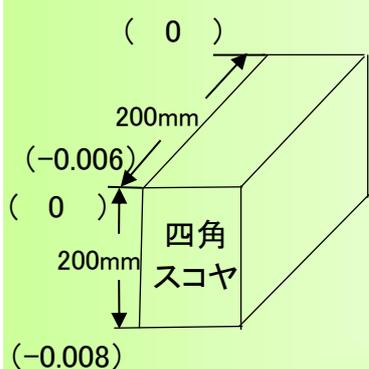

2024/9/10

2/2ページ

**EAST JAPAN MACHINE PLAZA**