


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2007	管理番号	P008662
型式	TC-S2C	測定者	平野	アシスタント	野辺沼

## 振り回し(200ピッチ)

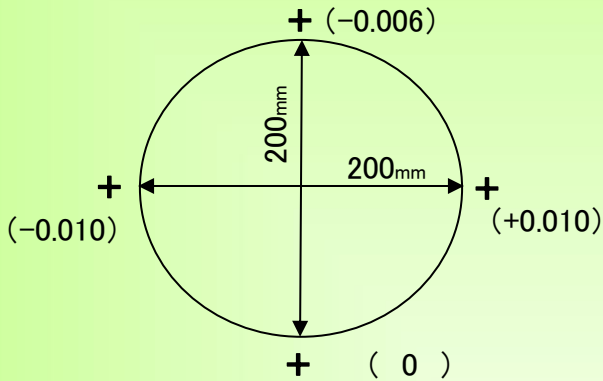

## 主軸振れ



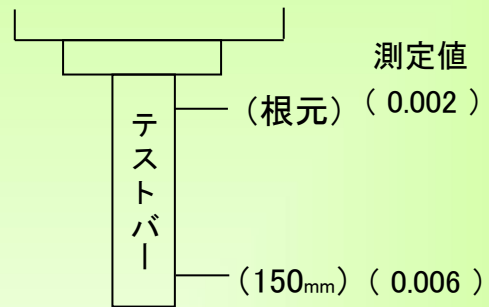


## 直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.016)

【XY】測定値 (0.016)

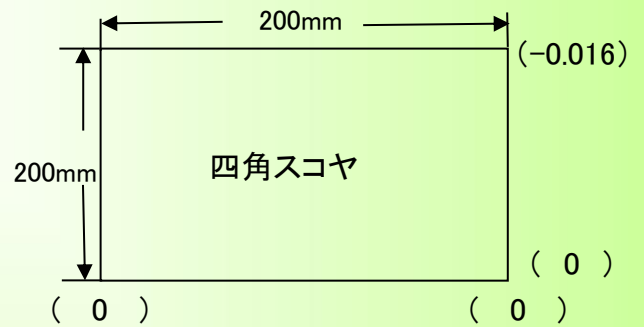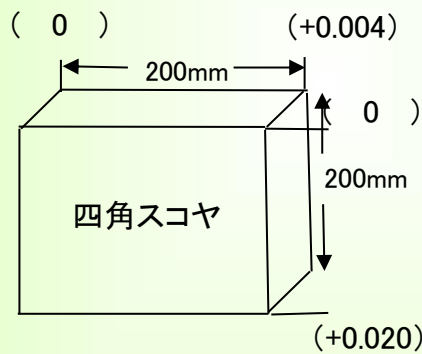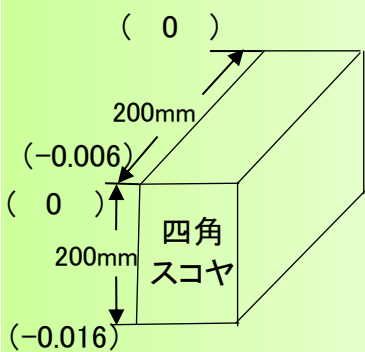

## 上面精度

※テーブルサイズ 600×320

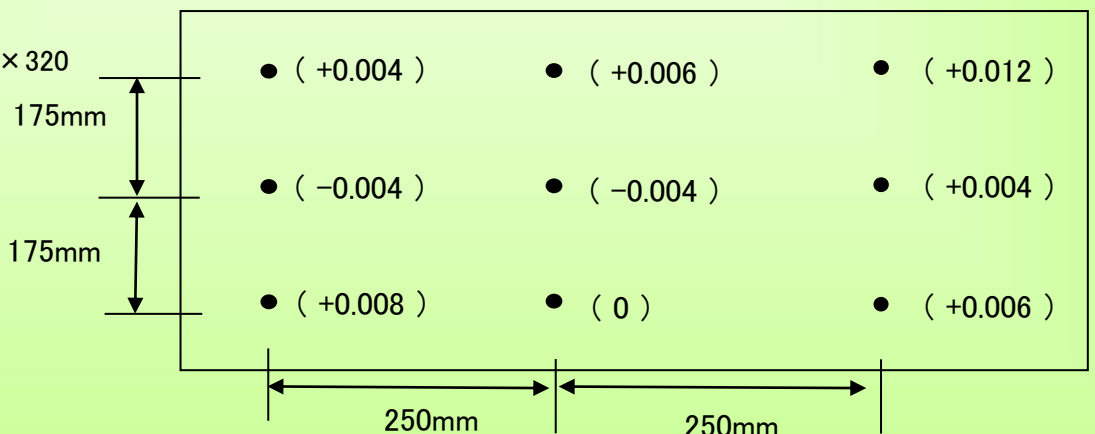

2024/9/14