


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2015.10	管理番号	P008603
型式	MILLAC-611V II	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

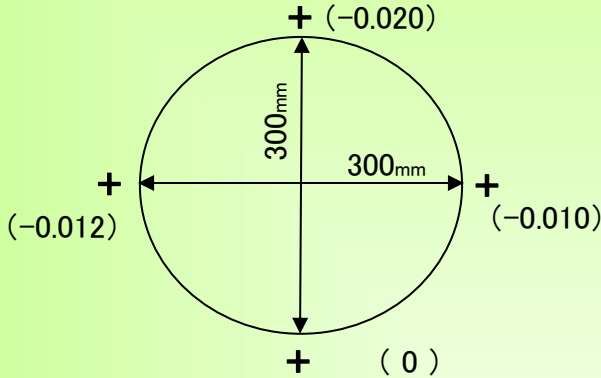

主軸振れ



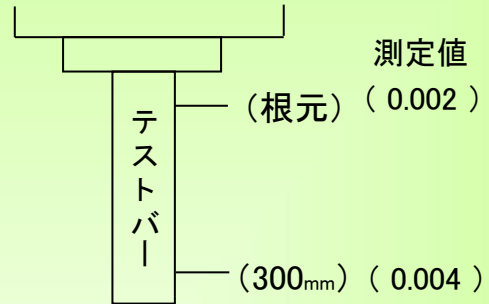


直角度

【YZ】測定値 (0.010)

【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.006)

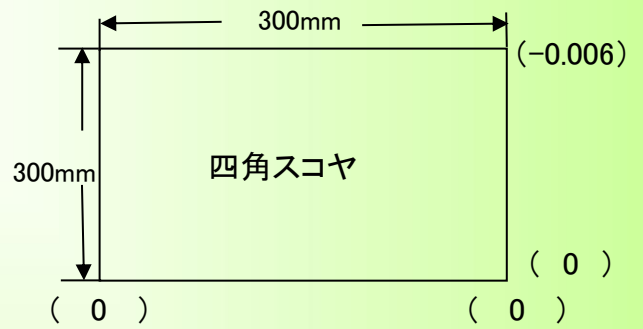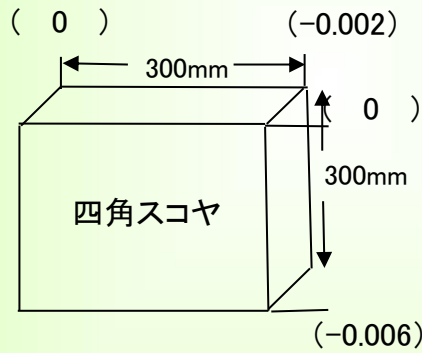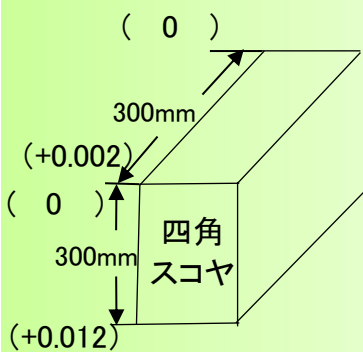


上面精度

※テーブルサイズ

1600 × 610

300mm

240mm

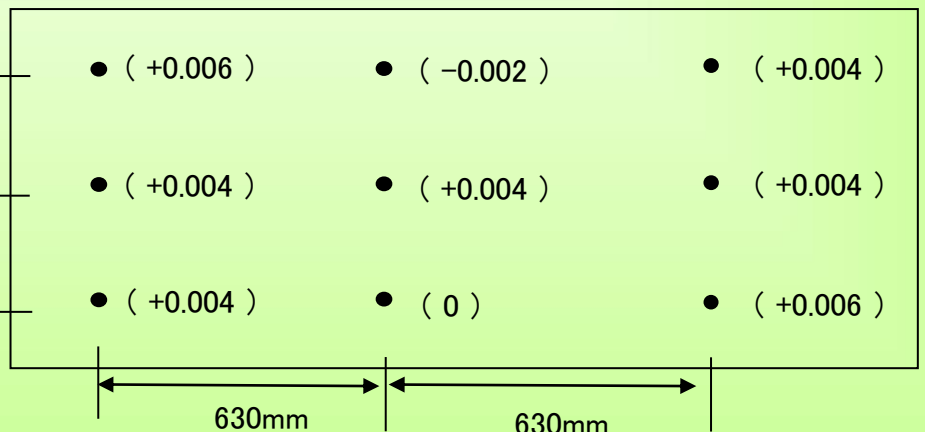

2024/7/26