


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2007	管理番号	P008621
型式	NV5000 α 1A/40	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

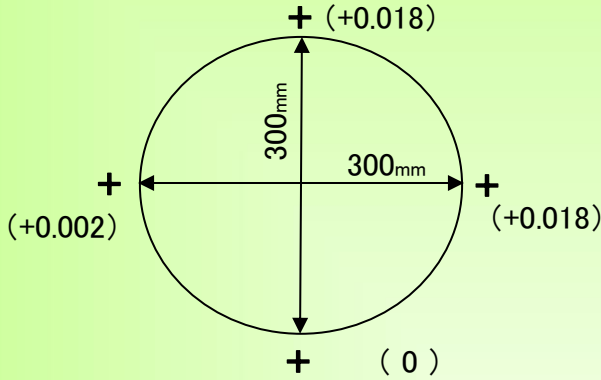

## 主軸振れ



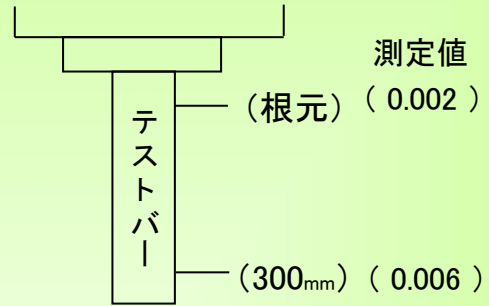


## 直角度

【YZ】測定値 (0.010)

【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.012)

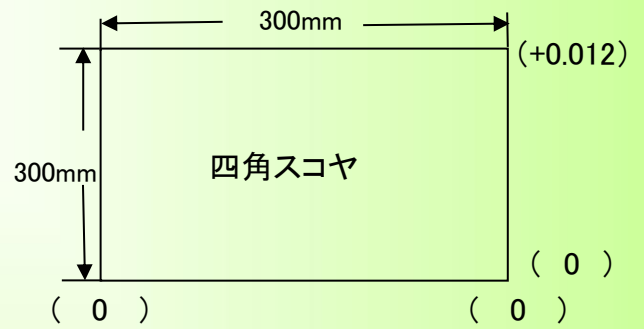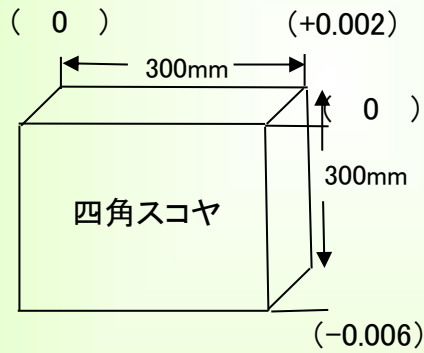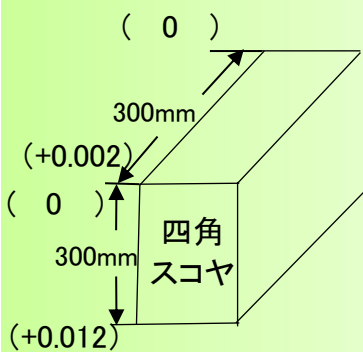


## 上面精度

※テーブルサイズ

1100 × 600

230mm

230mm

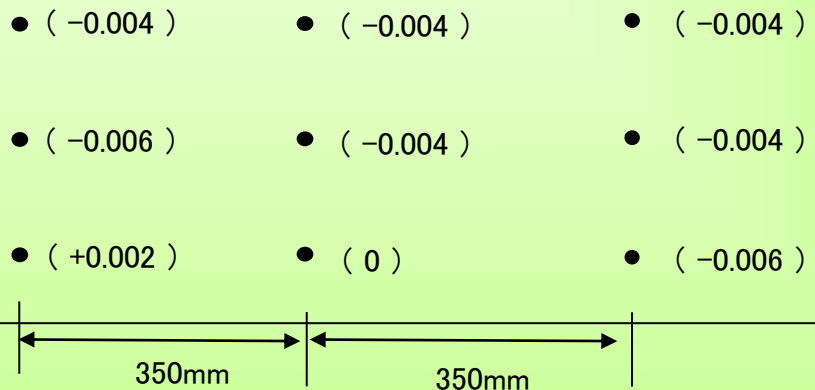

2024/8/1