


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	松浦	年式	2017	管理番号	P008576
型式	MX-850	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

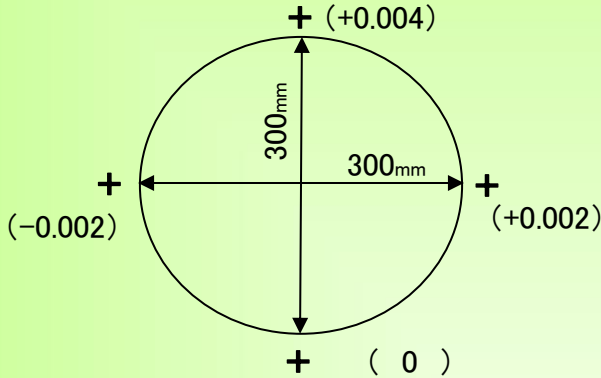

## 主軸振れ



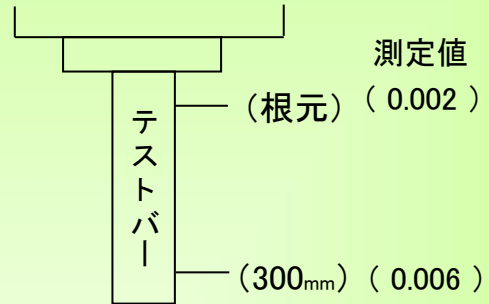


## 直角度

【YZ】測定値 (0.012)



【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.006)

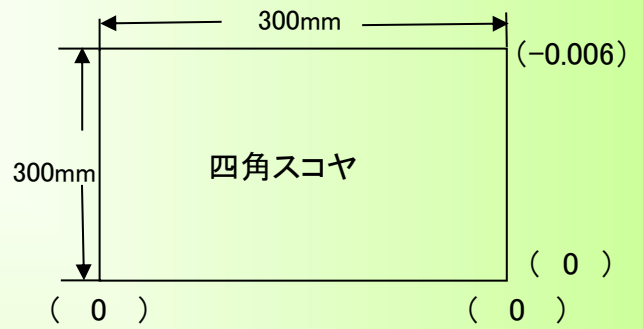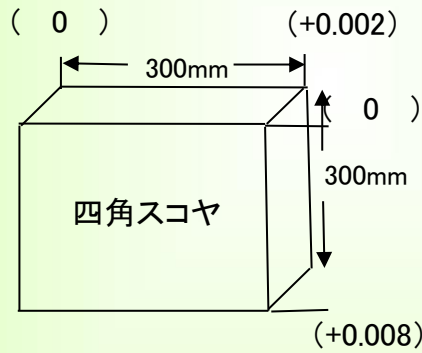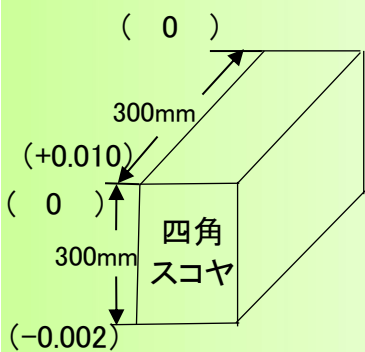

## 上面精度

※テーブルサイズ Φ700

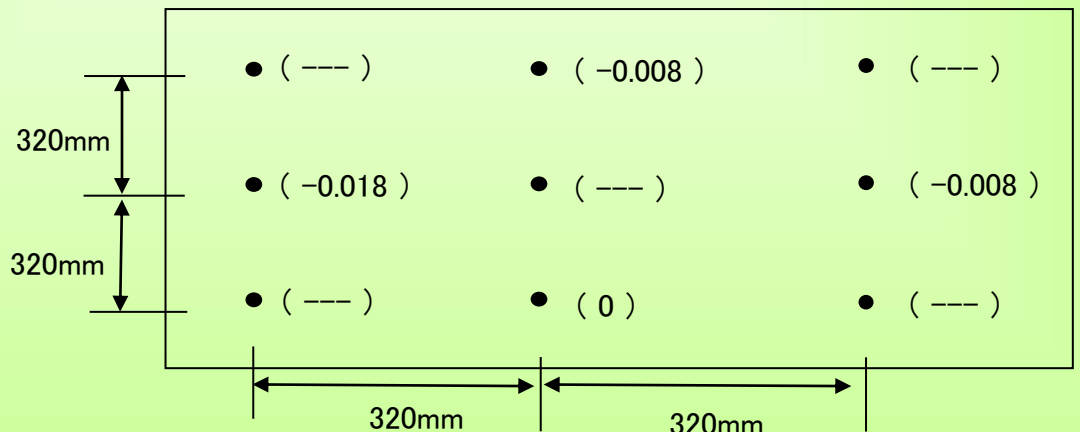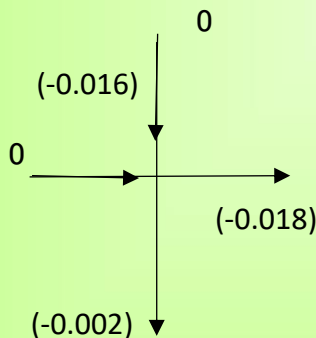

2024/9/12