


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	松浦	年式	2018.3	管理番号	P008577
型式	MX-850	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

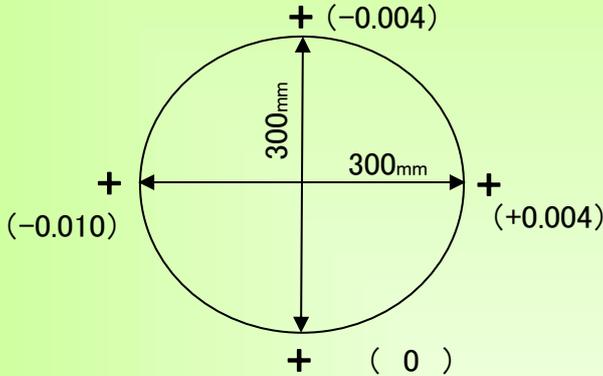

主軸振れ


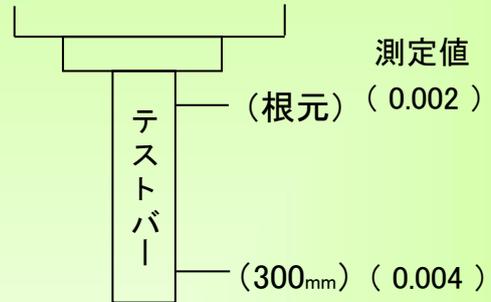


直角度

【YZ】測定値 (0.006)

【XZ】測定値 (0.008)



【XY】測定値 (0.004)

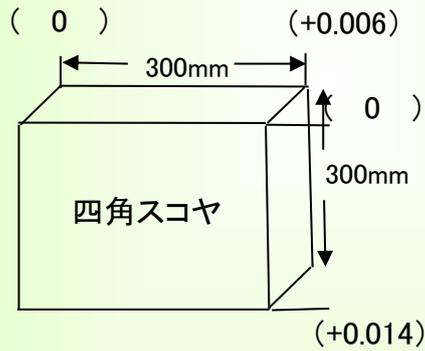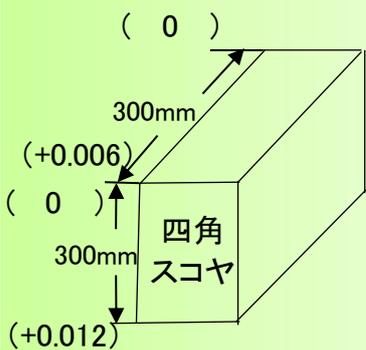

上面精度

※テーブルサイズ Φ700

【B軸】-90°

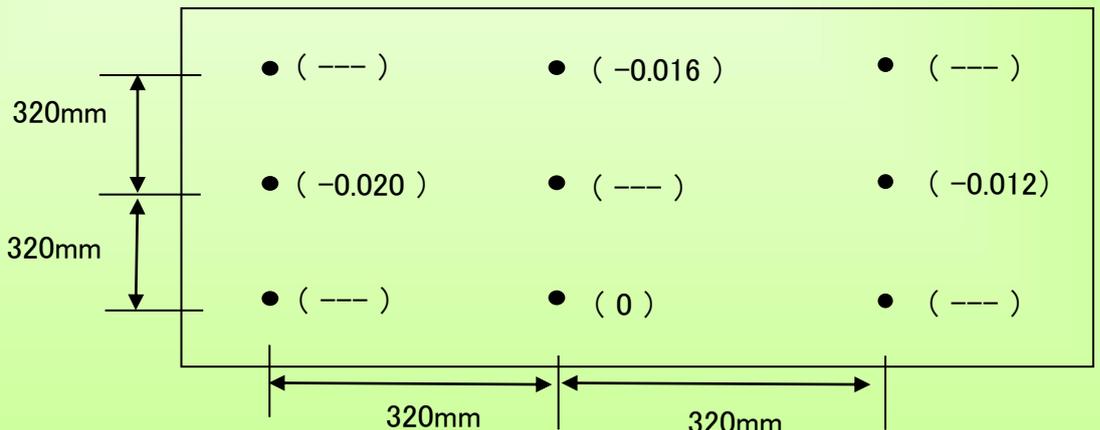

2024/9/12