


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	山崎技研	年式	2000	管理番号	P008705
型式	YZ-500SG	測定者	野辺 沼	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

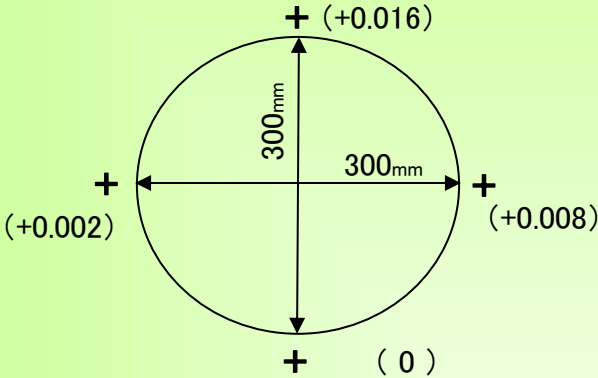

主軸振れ



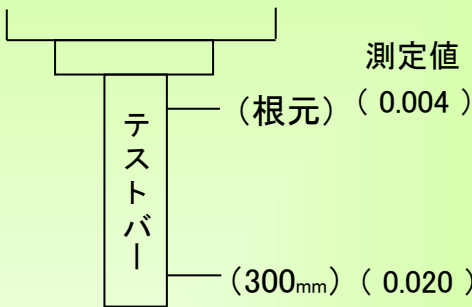


直角度

【YZ】 測定値 (0.014)

【XZ】 測定値 (0.006)

【X Y】 測定値 (0.004)

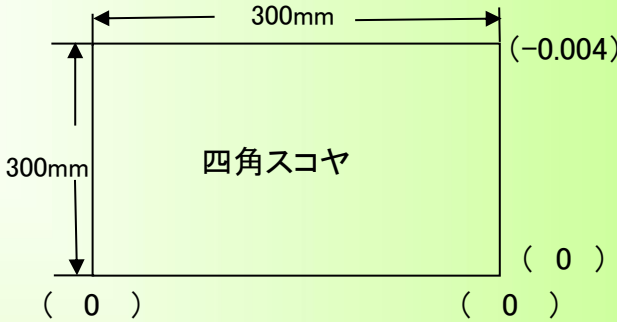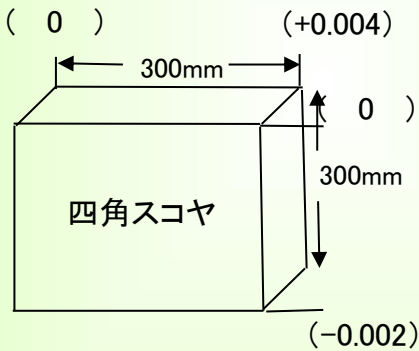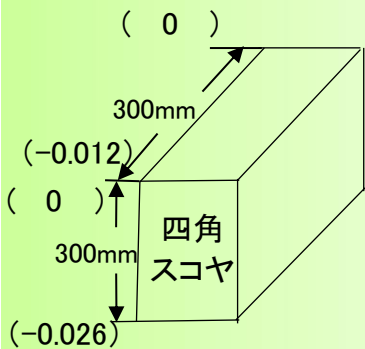

上面精度

※テーブルサイズ 1600×5000

215mm

215mm

● (+0.024)

● (+0.022)

● (+0.032)

● (+0.004)

● (-0.004)

● (+0.010)

● (+0.002)

● (0)

● (+0.006)

575mm

575mm

2024/10/3