


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	森精機	年式	2003	管理番号	P008649
型式	NV5000B/50	測定者		アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

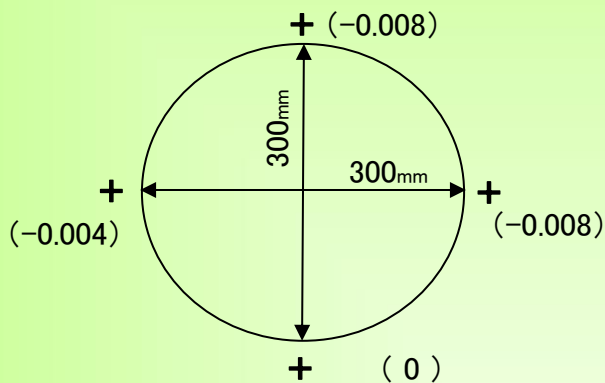

## 主軸振れ



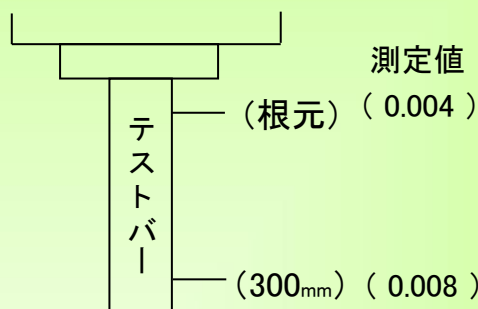


## 直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.006)

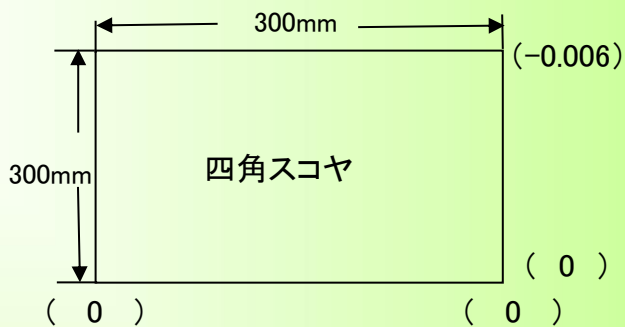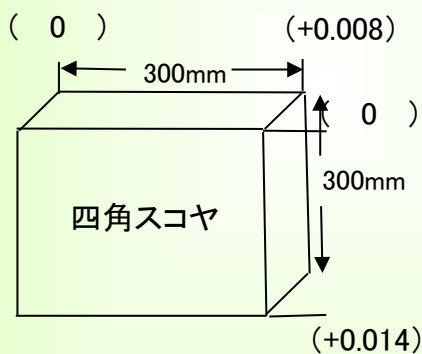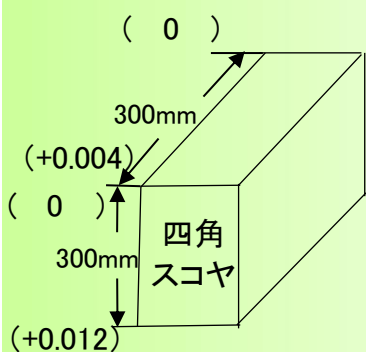

## 上面精度

※テーブルサイズ 1320×600

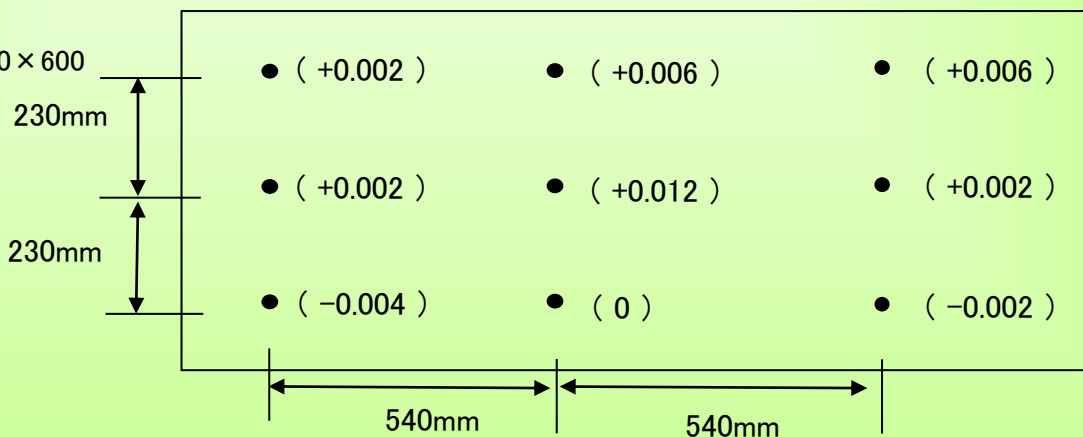

2024/10/7