


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2006	管理番号	H018673
型式	RRM-2P	測定者	仙田	アシスタント	蔵内

## Z軸方向の平行度

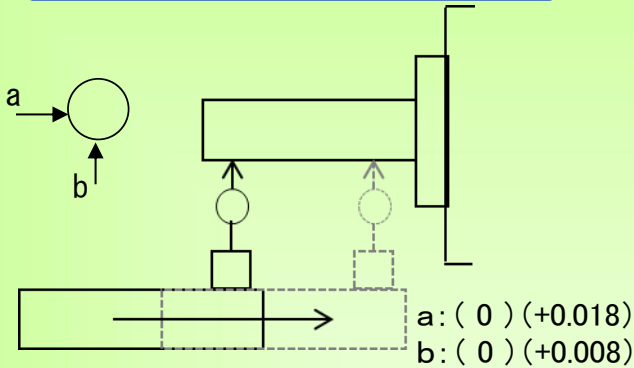

## 主軸振れ



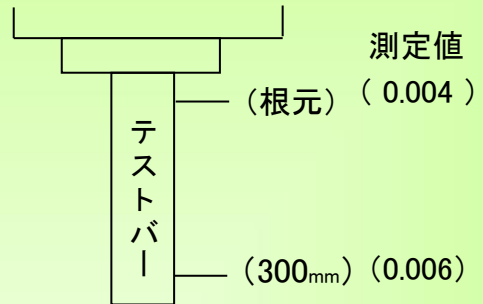


## 直角度

【XY】測定値 (0.015)

【ZY】測定値 (0.014)

【ZX】測定値 (0.016)

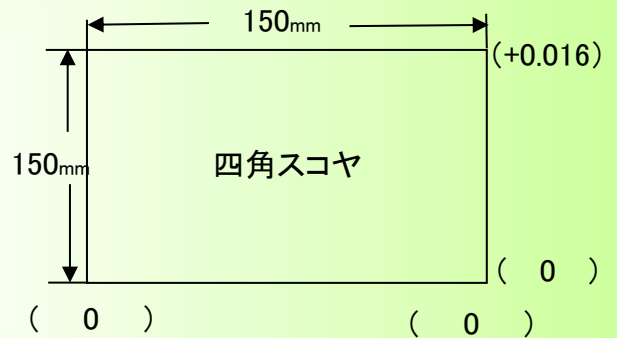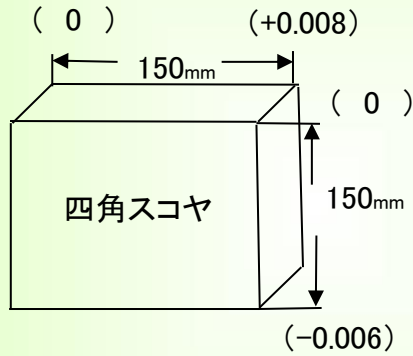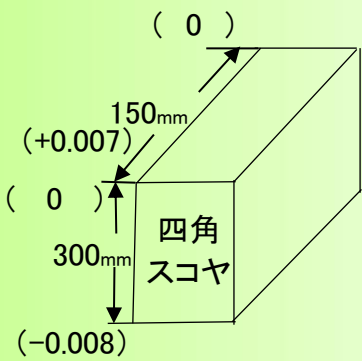


## 上面精度

テーブルサイズ: 1110 × 190

( )パレット1

[ - ]パレット2

X軸-異音小

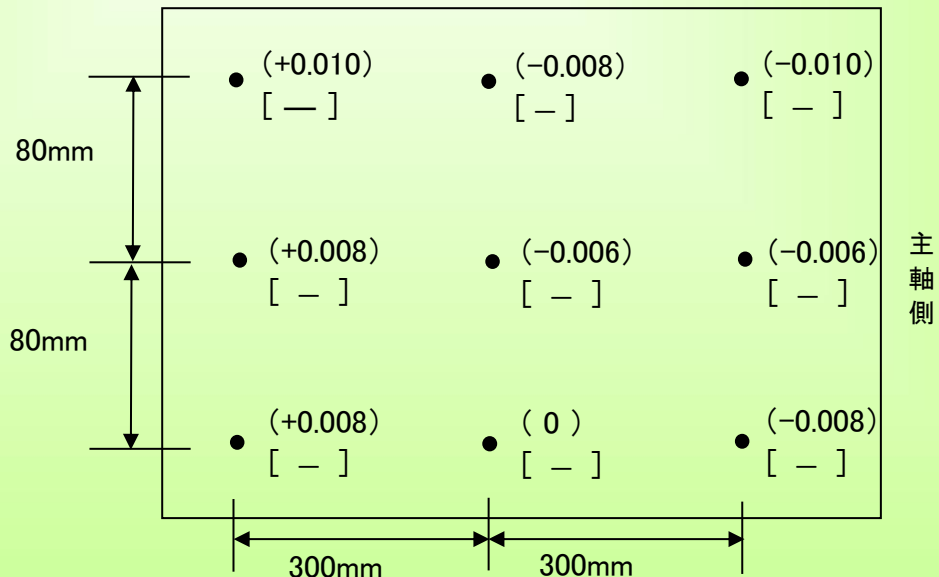

2024/7/4