


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2004.11	管理番号	P008691
型式	α -T14iDL	測定者	近藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

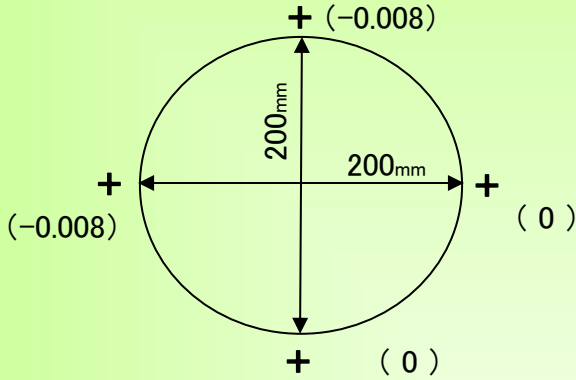

主軸振れ



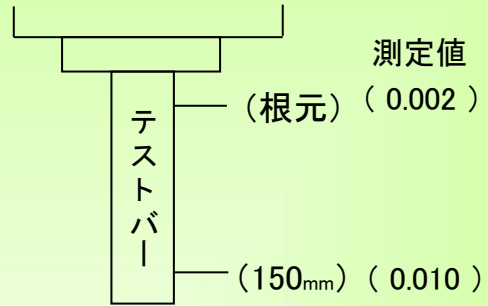


直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.012)

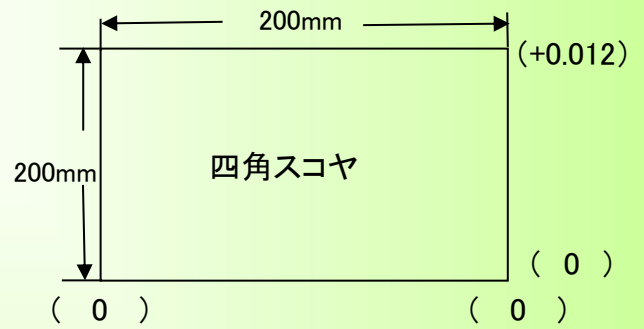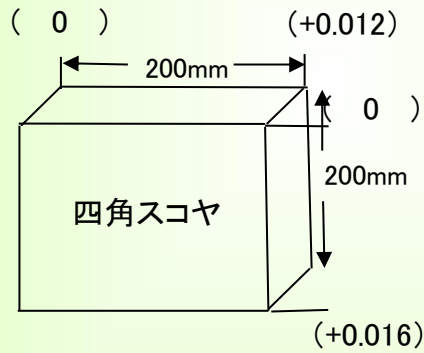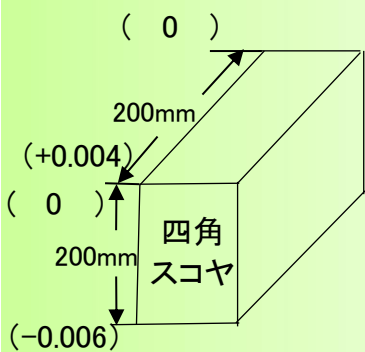

上面精度

※テーブルサイズ 850×410

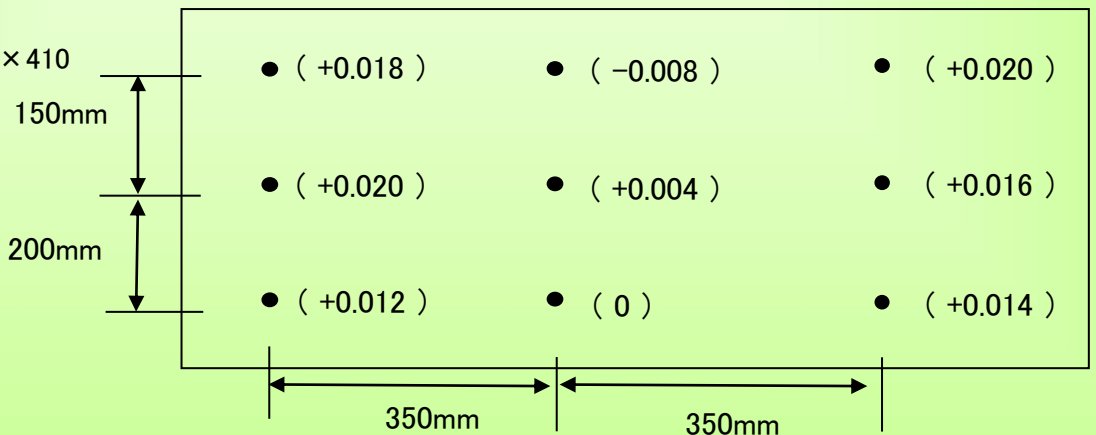

2024/10/22