


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2004.11	管理番号	P008690
型式	α -T14iDL	測定者	近藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

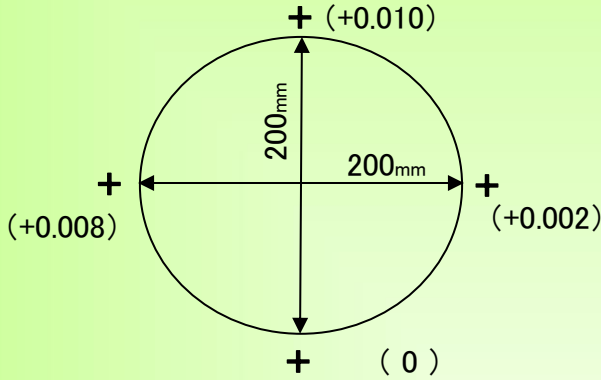

主軸振れ


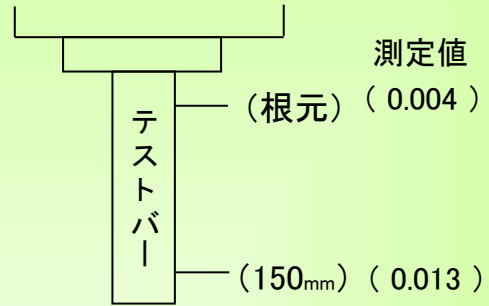


直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.004)

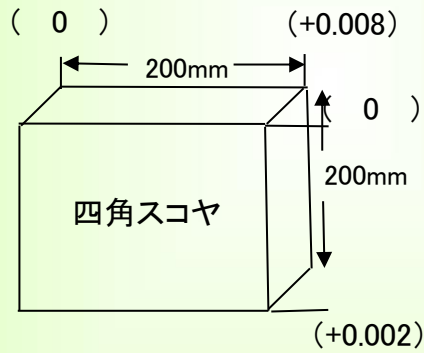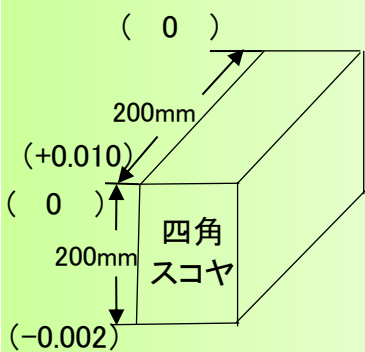

上面精度

※テーブルサイズ 850×410

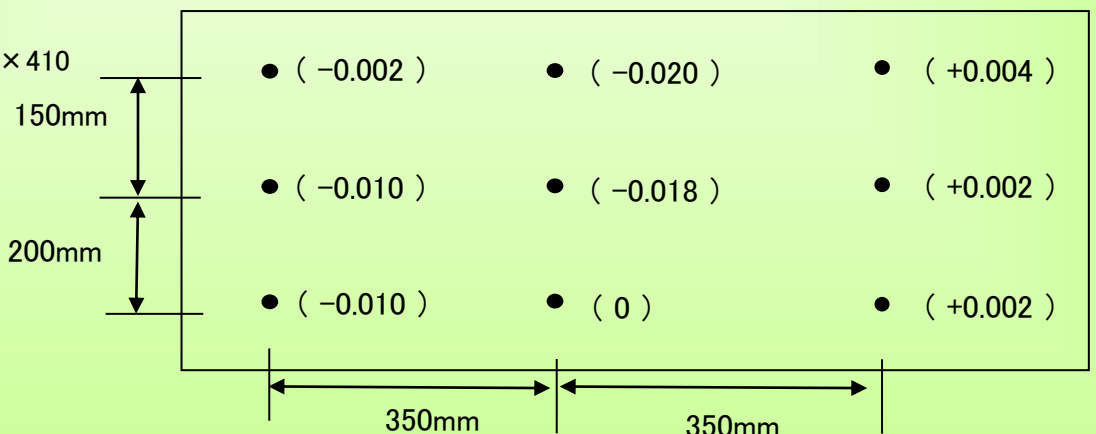

2024/10/22