


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2015	管理番号	P008601
型式	MILLAC-611V II	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

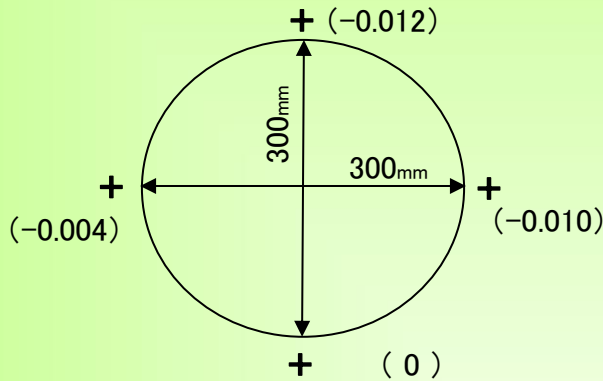

主軸振れ



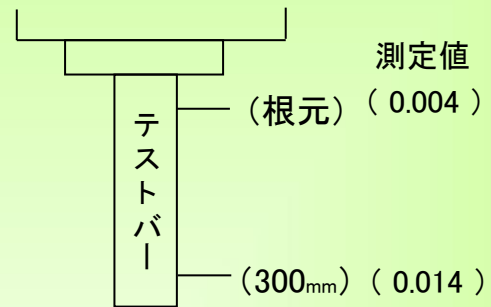


直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.006)

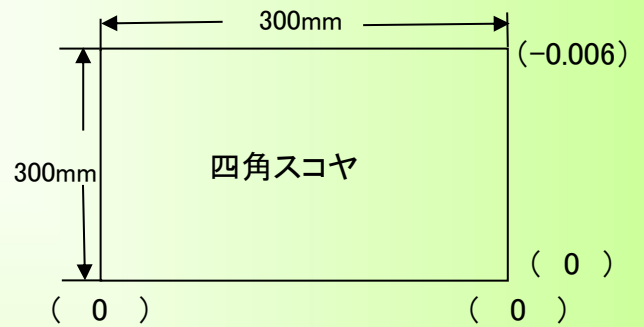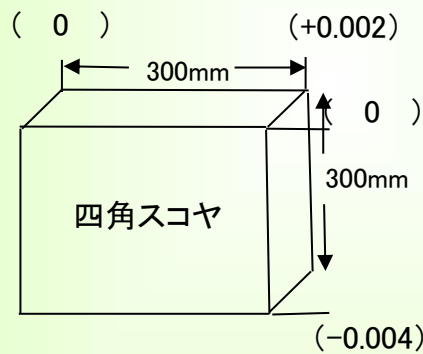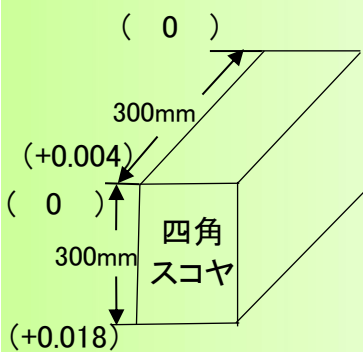

上面精度

※テーブルサイズ 1600×610

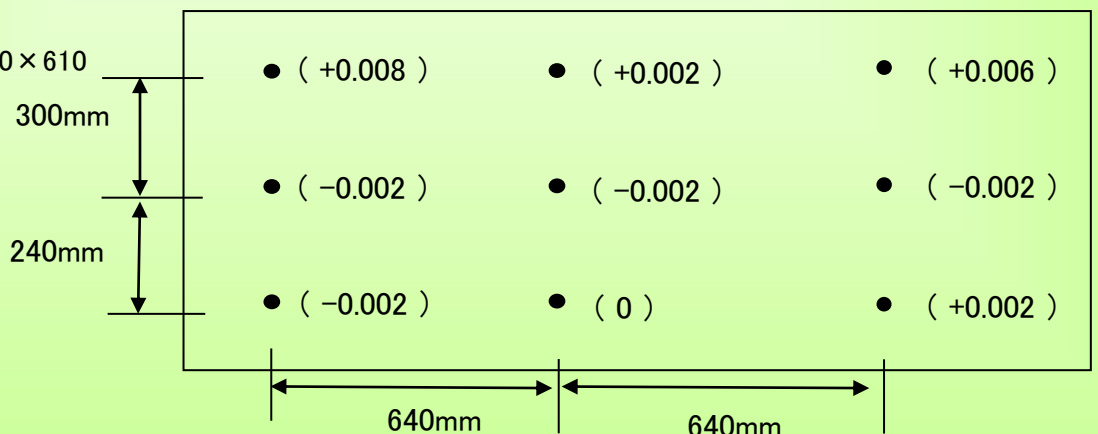

2024/10/23