


精度測定検査表


Examination for precision list

| | | | | | |
|------|-----------------|-----|------|--------|---------|
| メーカー | ファナック | 年式 | 2008 | 管理番号 | P008597 |
| 型式 | α -T21iF | 測定者 | 近藤 | アシスタント | |

振り回し(200ピッチ)

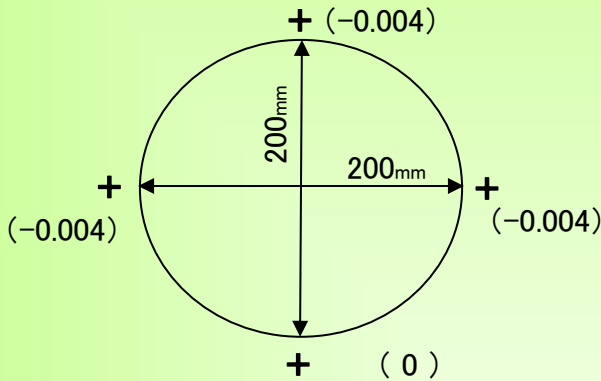

主軸振れ



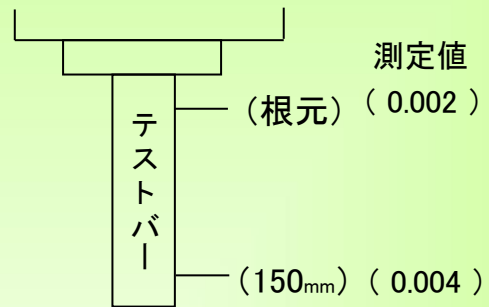


直角度

【YZ】測定値 (0.002)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.010)

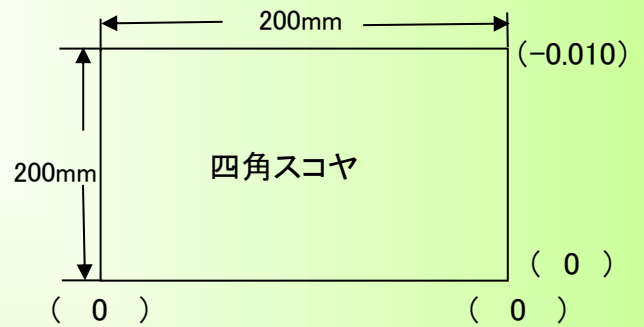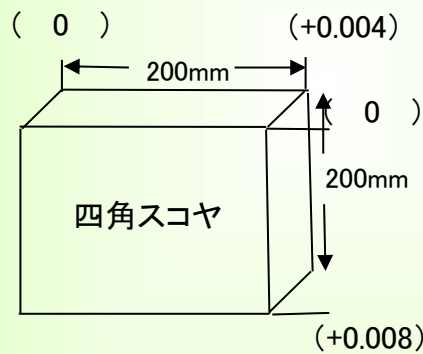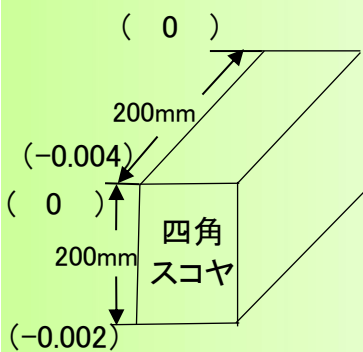

上面精度

※テーブルサイズ 400×650

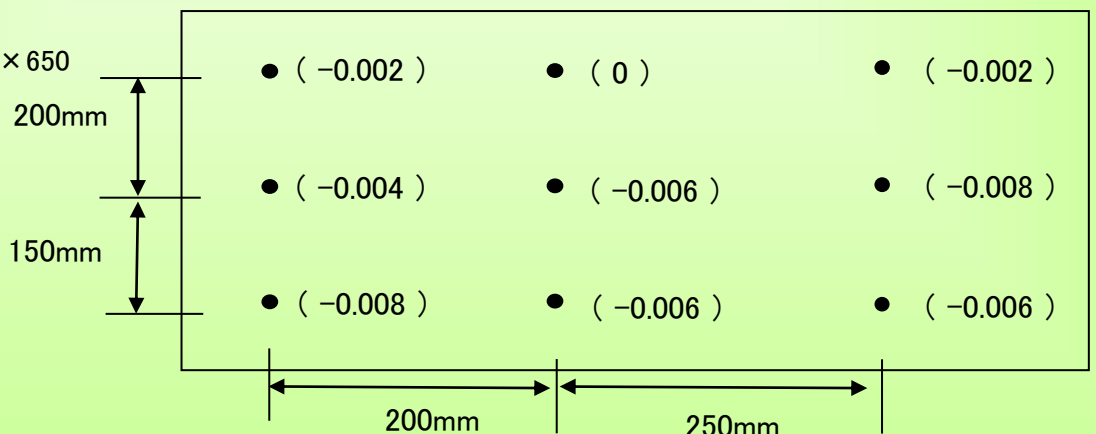

2024/10/23