


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2004	管理番号	P008657
型式	MILLAC-415V	測定者	立川	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

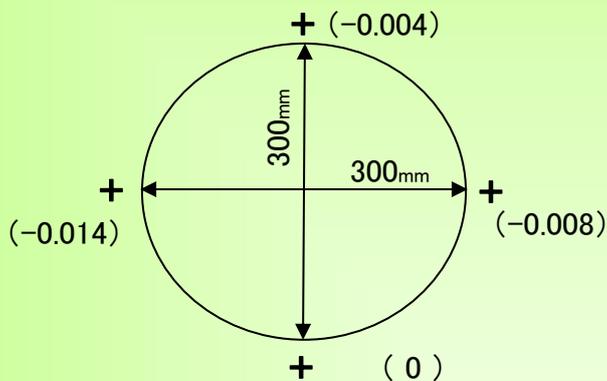

主軸振れ



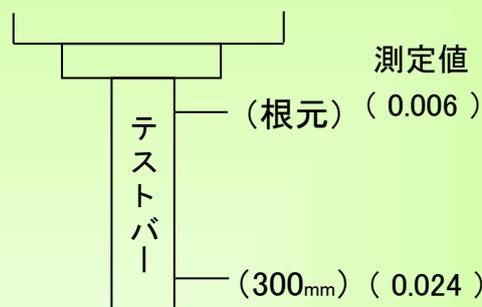


直角度

【YZ】測定値 (0.008)

【XZ】測定値 (0.016)


【XY】測定値 (0.004)

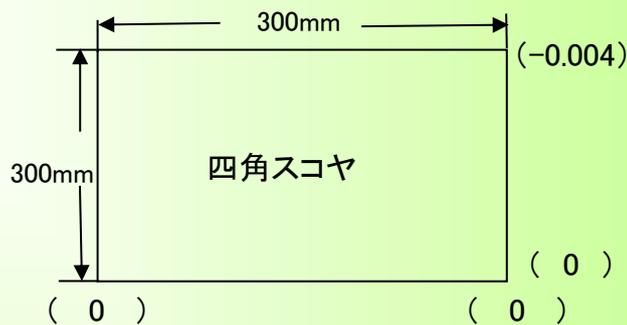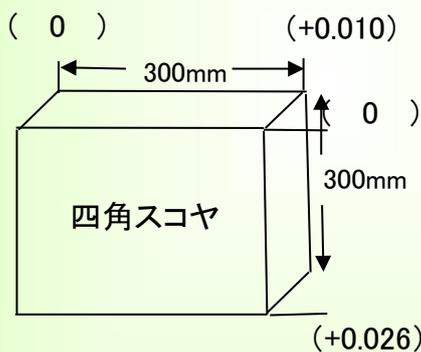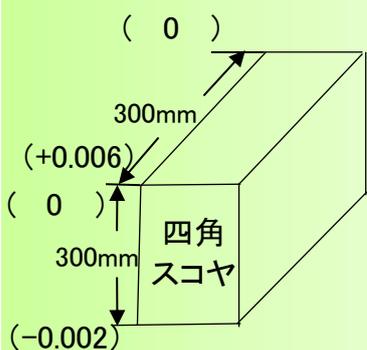

上面精度

バックラッシュ X軸 0.002 Y軸 0.004 Z軸 0.002

※テーブルサイズ 700×400

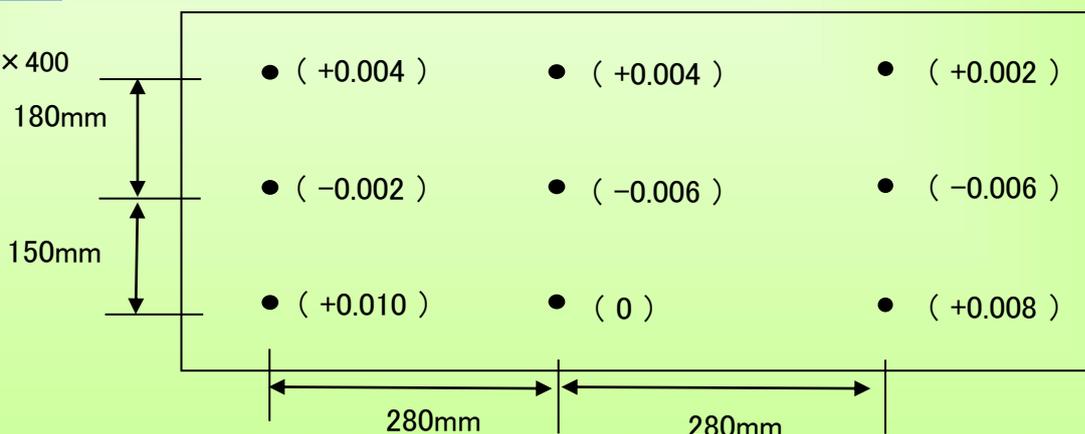

2024/11/15