


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	滝沢	年式	2017	管理番号	P008663
型式	MAC-Y520	測定者	武藤	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

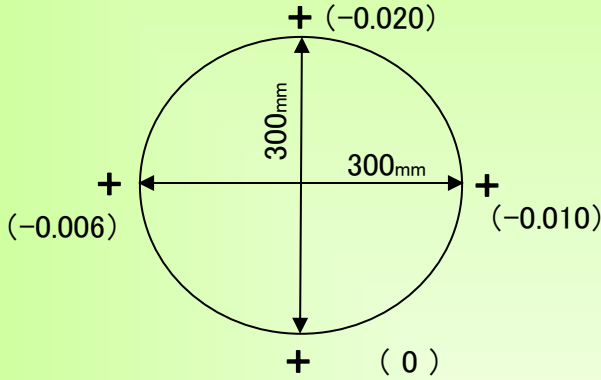

## 主軸振れ



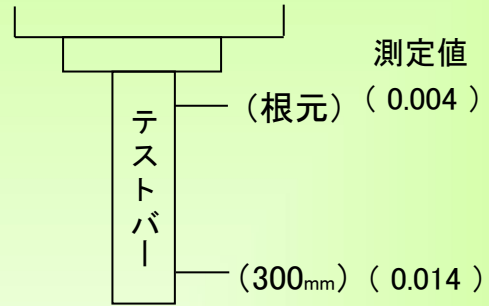


## 直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.008)

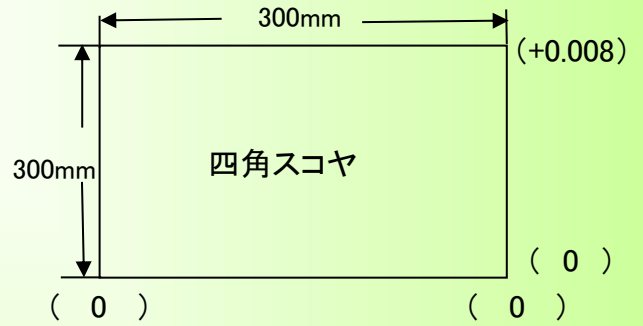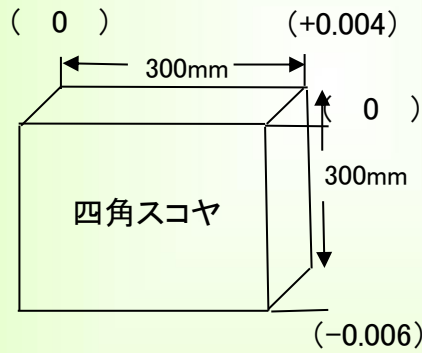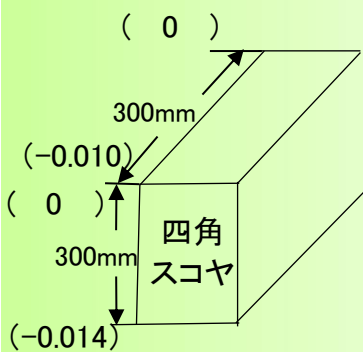

## 上面精度

※テーブルサイズ 1000×520

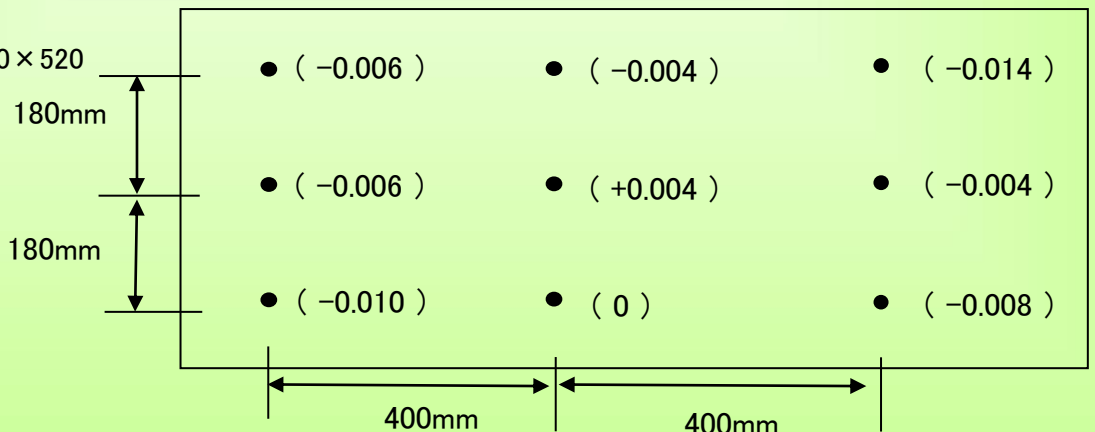

2024/11/30