


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2003	管理番号	P008711
型式	MILLAC-561V	測定者	武藤	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

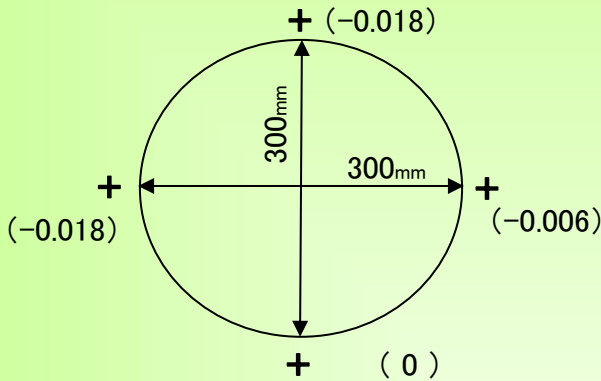

## 主軸振れ



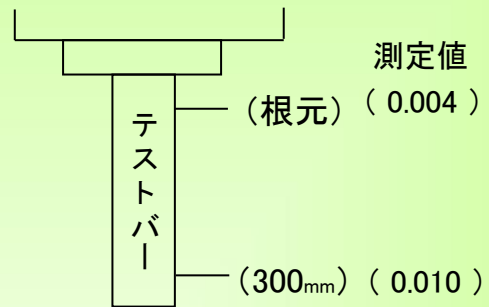


## 直角度

【YZ】測定値 (0.018)


【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.006)

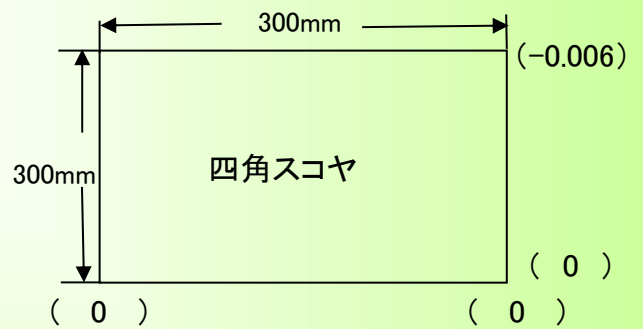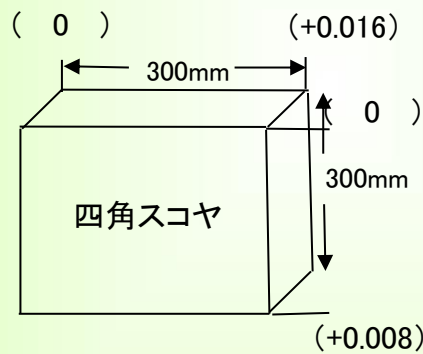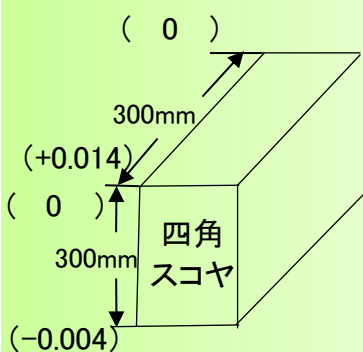

## 上面精度

※テーブルサイズ 1350×560

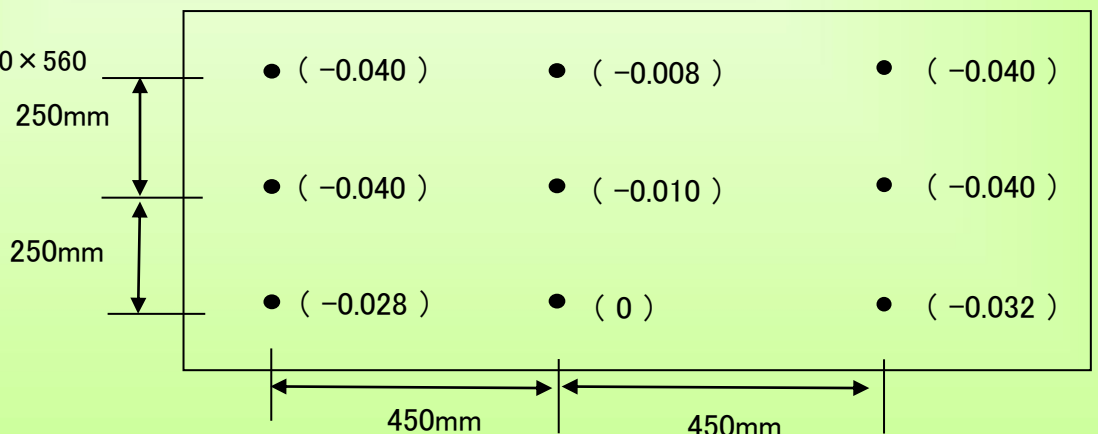

2024/11/25