


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	北村	年式	2003	管理番号	P008652
型式	Mycenter-HX500i	測定者	野辺沼	アシスタント	

Z軸方向の平行度

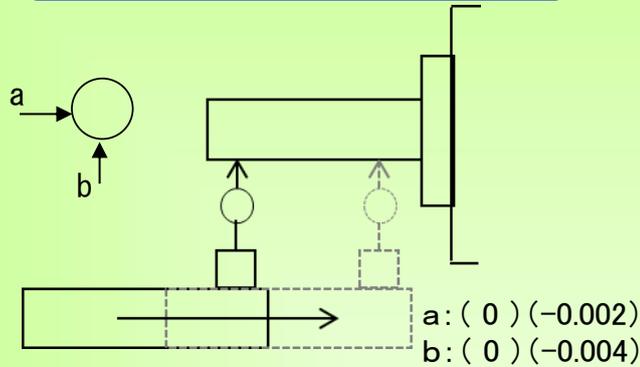

主軸振れ


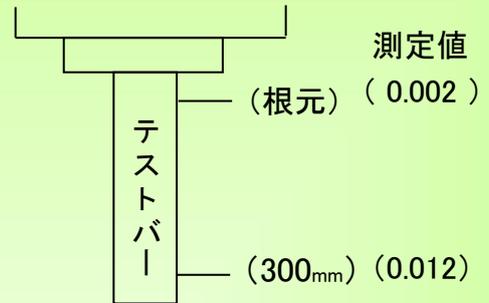


直角度

【XY】測定値 (0.016)


【ZY】測定値 (0.022)

【ZX】測定値 (0.004)

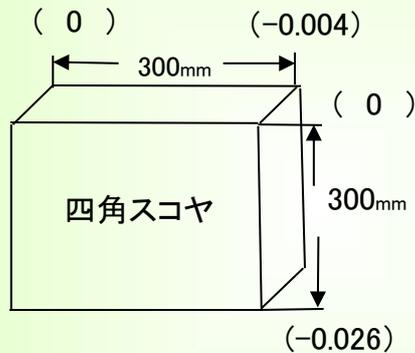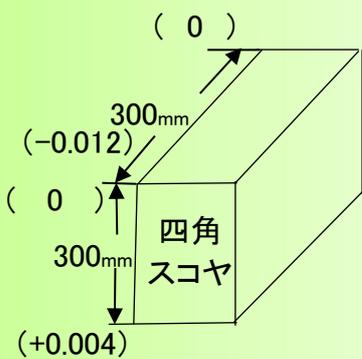

上面精度

テーブルサイズ: 500角
()パレット1
[—]パレット2

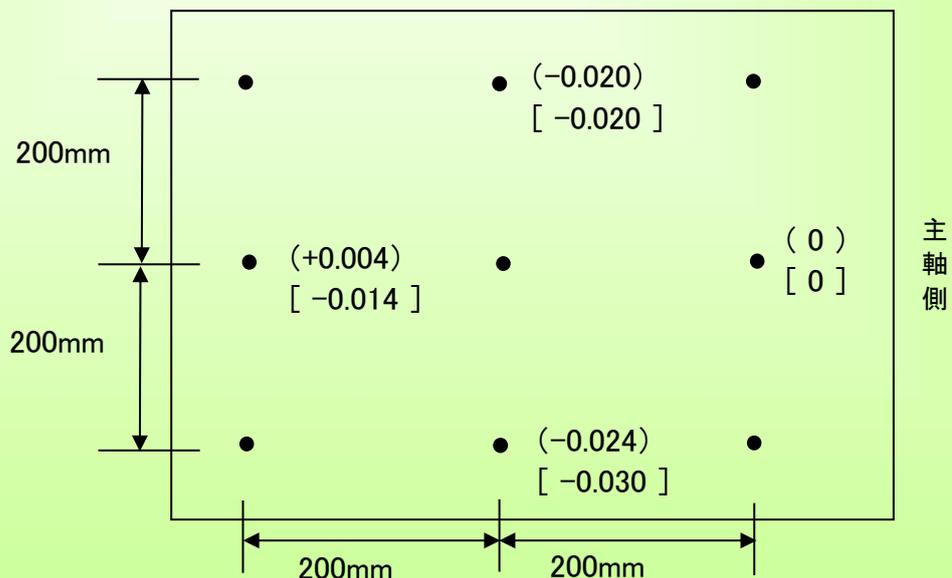

2024/12/2