


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2006	管理番号	P008619
型式	α -T21iEL	測定者	武藤・小山	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

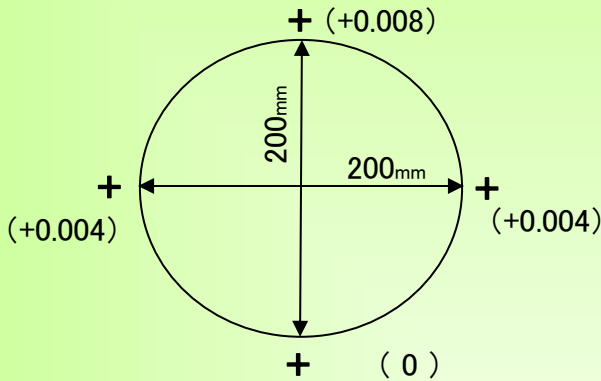

主軸振れ



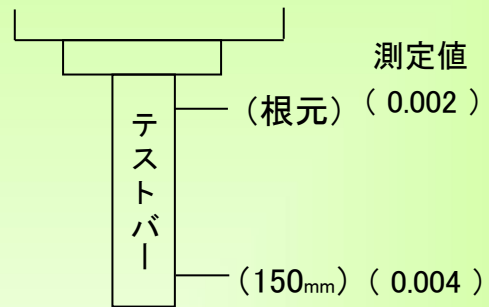


直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.020)

【XY】測定値 (0.008)

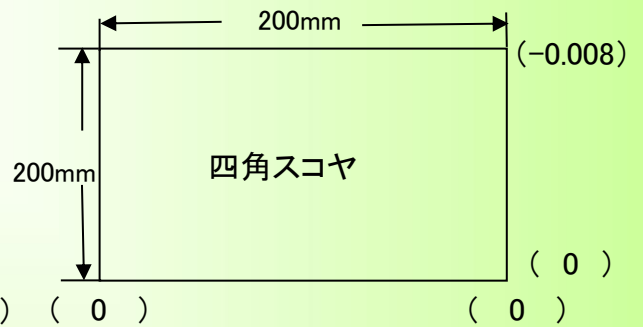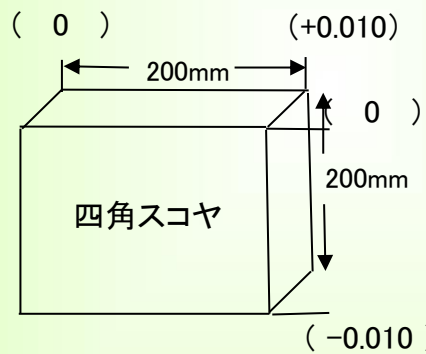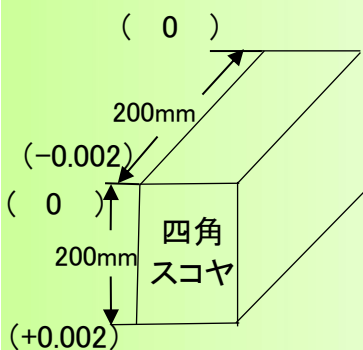

上面精度

※テーブルサイズ 850×410

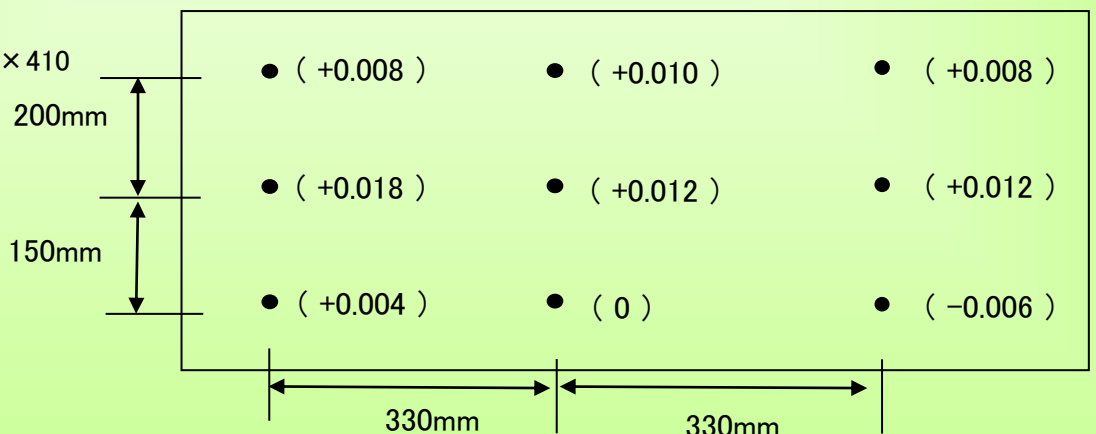

2024/12/13