


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	エツキ	年式	2016	管理番号	H018989
型式	2MF-VBS	測定者	山口	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

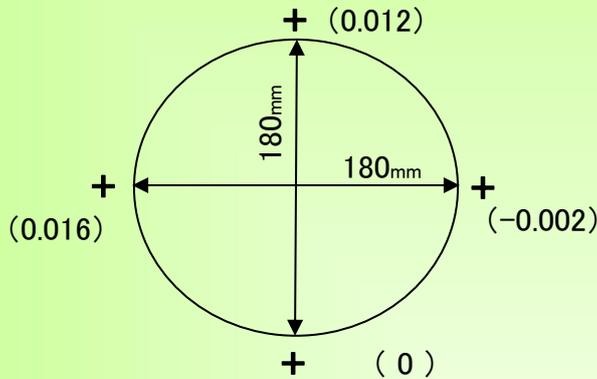

## 主軸振れ



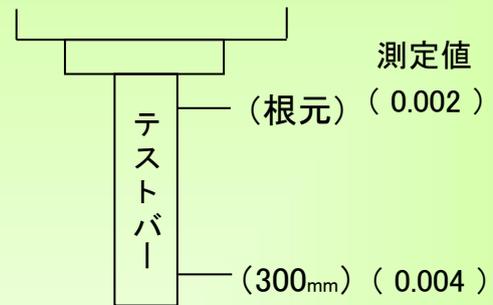


## 直角度

【YZ】測定値 (0.016)


【XZ】測定値 (0.014)

【XY】測定値 (0.004)

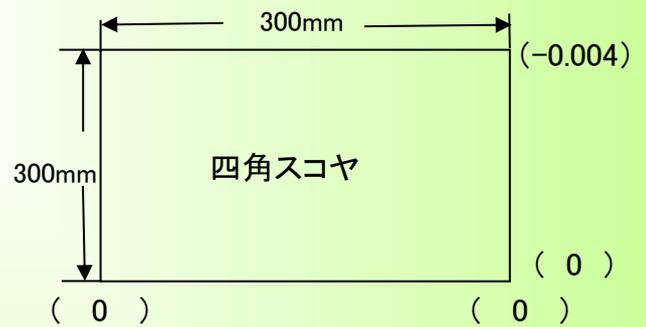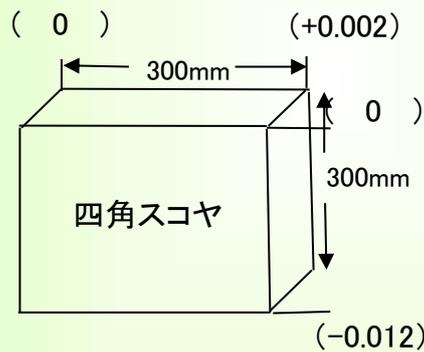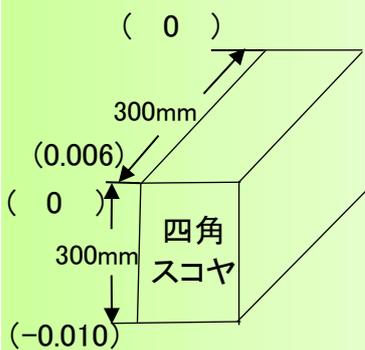

## 上面精度

※テーブルサイズ 290×1300

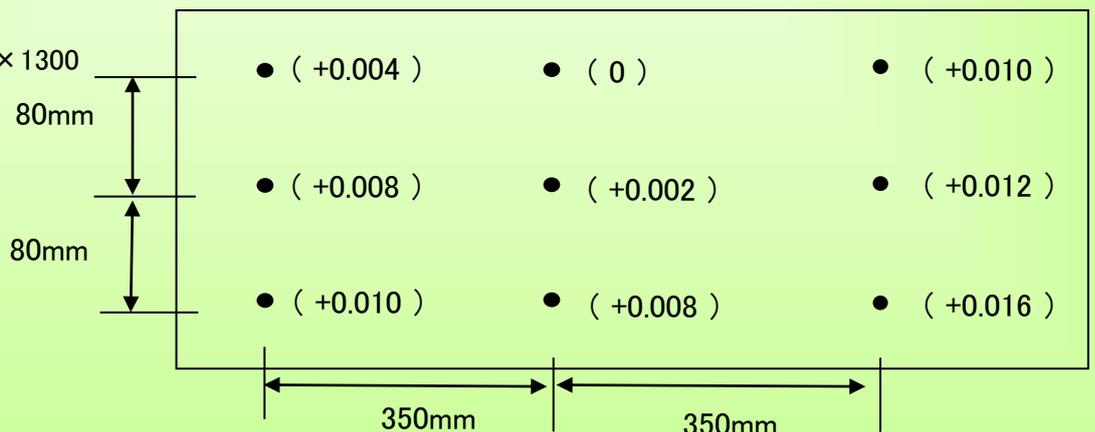

2024/2/3