


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	ファナック	年式	2005.12	管理番号	P008789
型式	$\alpha$ -T21iEL	測定者	立川	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

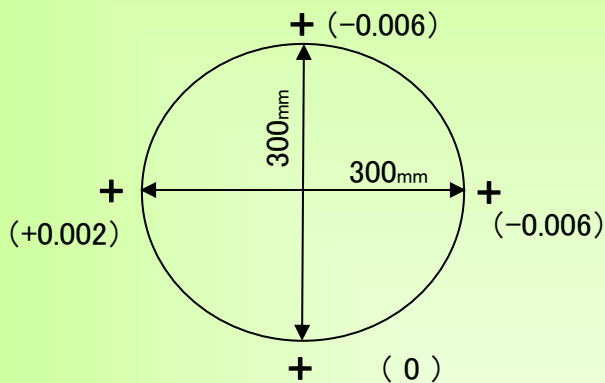

## 主軸振れ



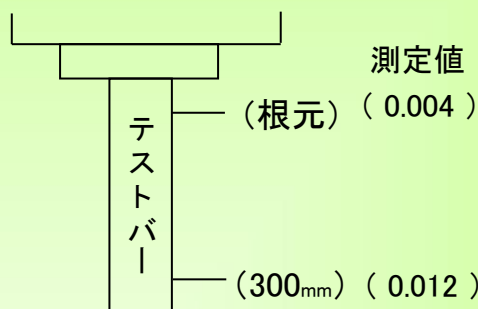


## 直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.002)

【XY】測定値 (0.006)

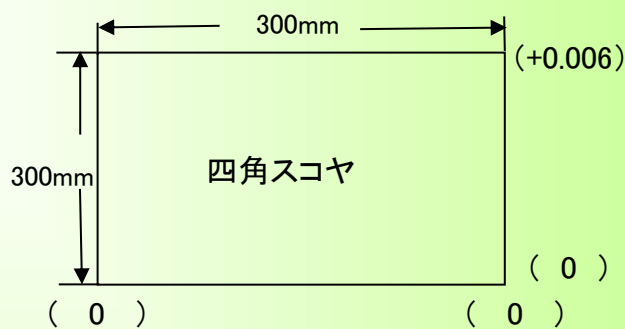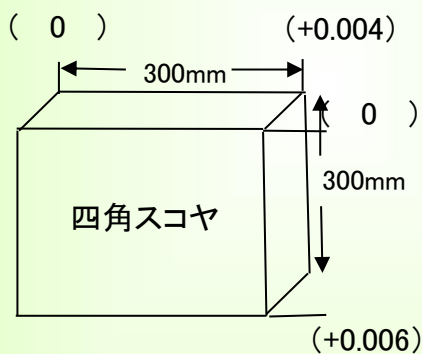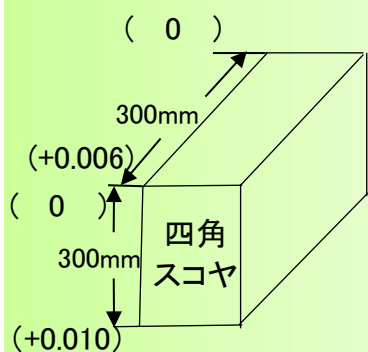

## 上面精度

※テーブルサイズ 850×410

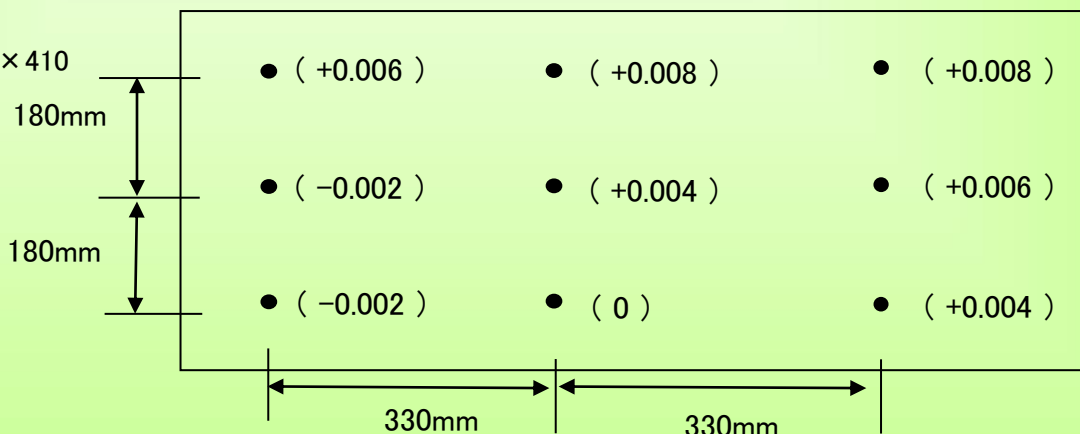

2024/1/30