


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	OKK	年式	2004	管理番号	P008756
型式	VM5III	測定者	野辺沼	アシスタント	立川

## 振り回し(300ピッチ)

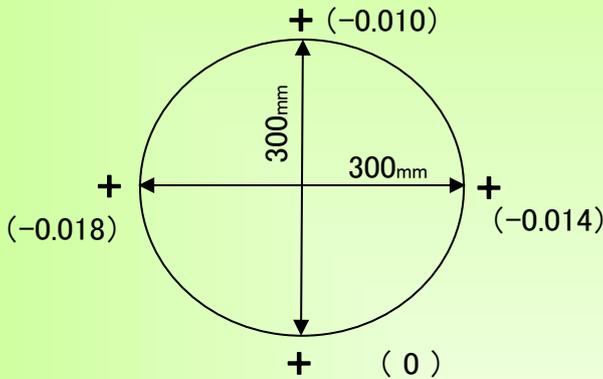

## 主軸振れ



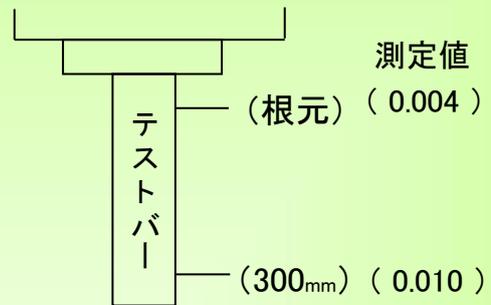


## 直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.006)

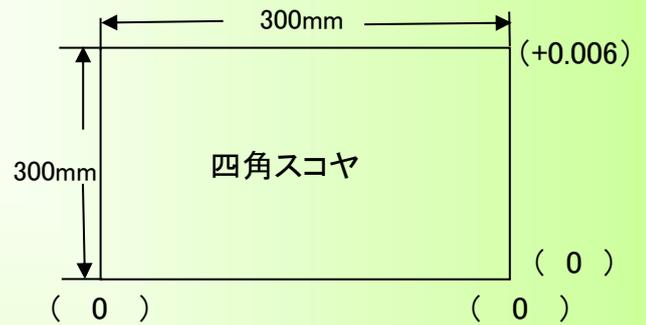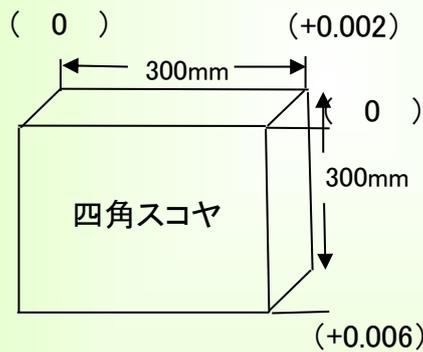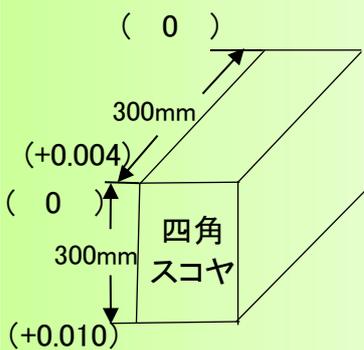

## 上面精度

※テーブルサイズ 1050×560

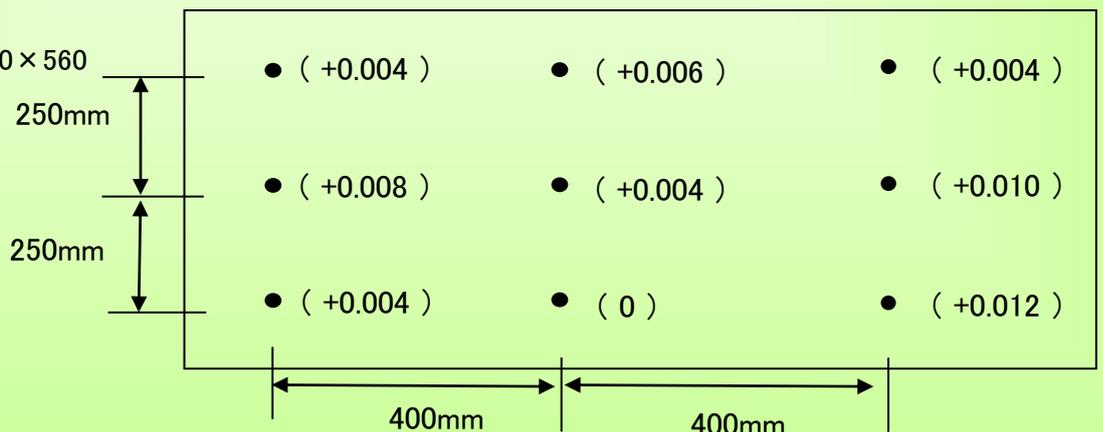

2024/2/6