


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2005	管理番号	P008371
型式	VP400	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

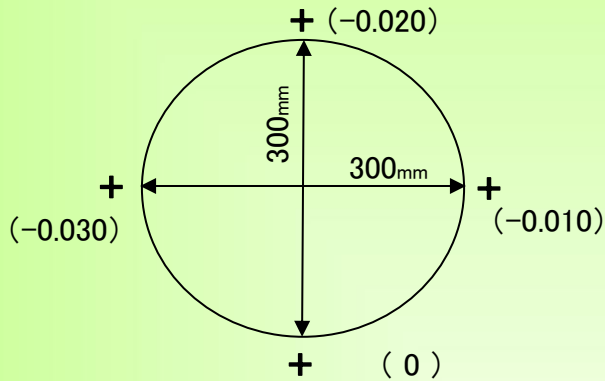

## 主軸振れ



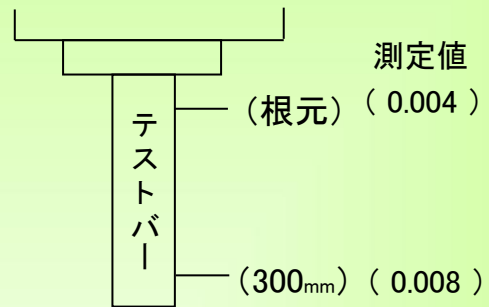


## 直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.004)

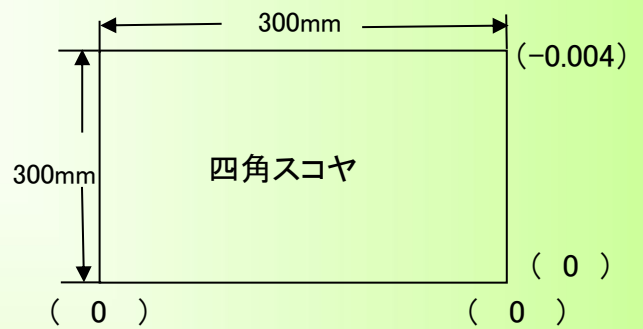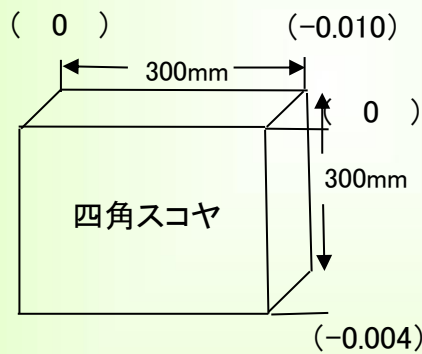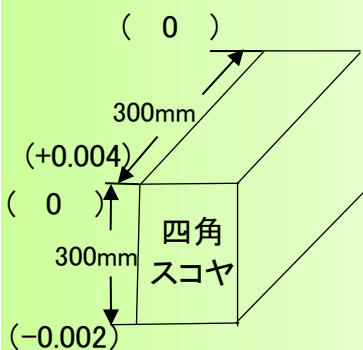

## 上面精度

※テーブルサイズ 900×410

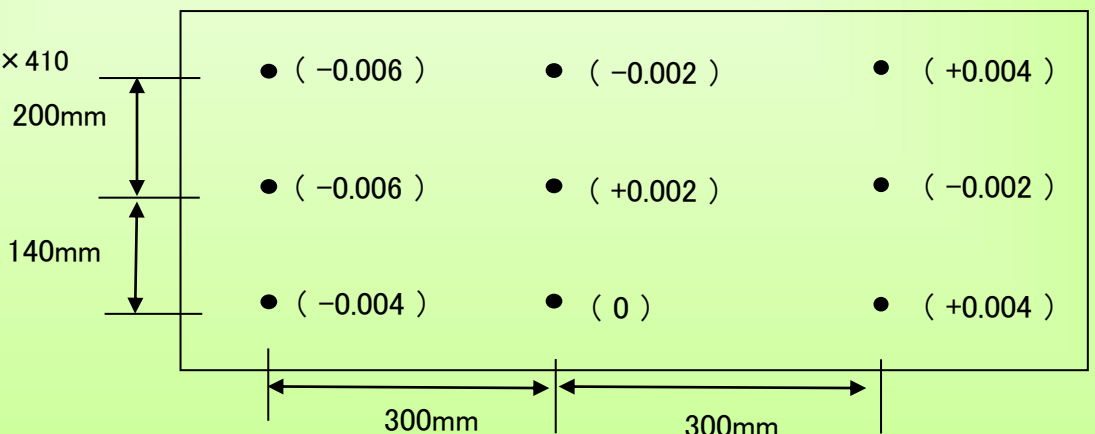

2024/2/7