


# 精度測定検査表


Examination for precision list

|      |           |     |      |        |         |
|------|-----------|-----|------|--------|---------|
| メーカー | 牧野フライス製作所 | 年式  | 2006 | 管理番号   | P008767 |
| 型式   | V33       | 測定者 | 野辺沼  | アシスタント |         |

## 振り回し(300ピッチ)

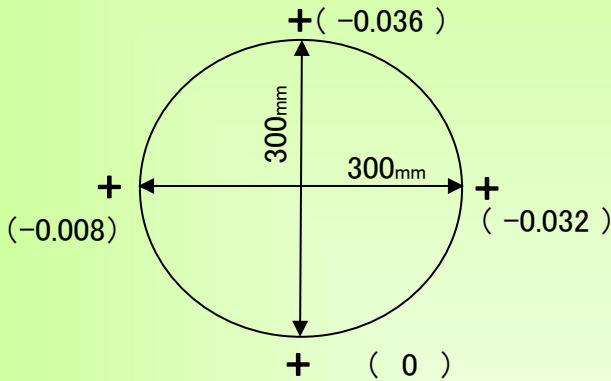

## 主軸振れ



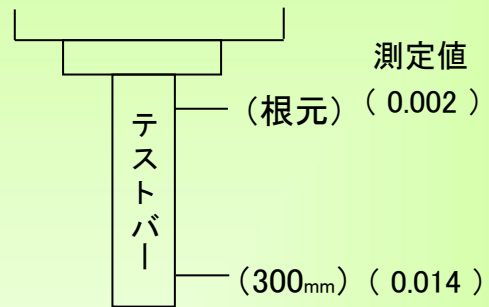


## 直角度

【YZ】測定値 (0.026)

【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.006)

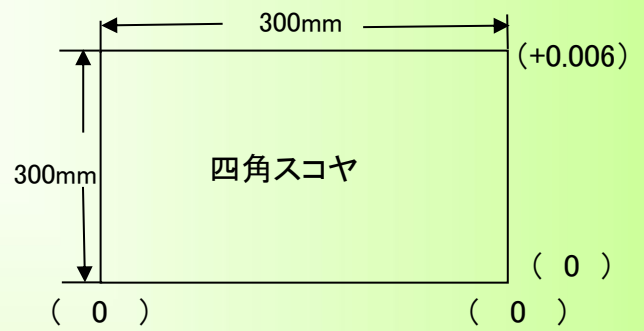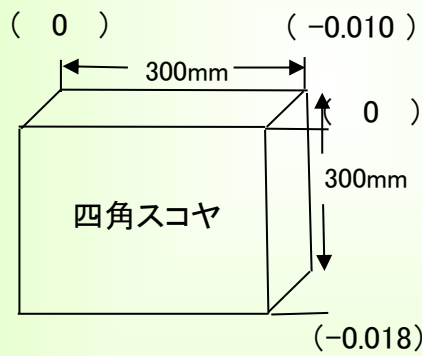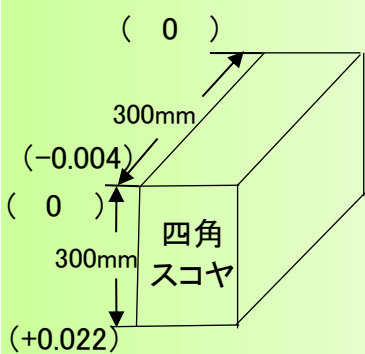


## 上面精度

※テーブルサイズ 700×340

No.1→ ( )

No.2→ < >

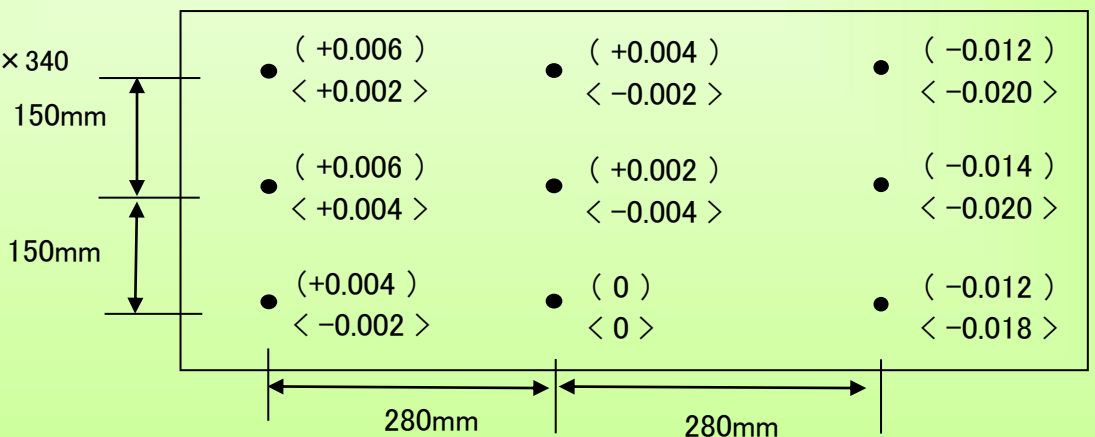

2025/2/20