


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2013	管理番号	P008702
型式	VC51	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

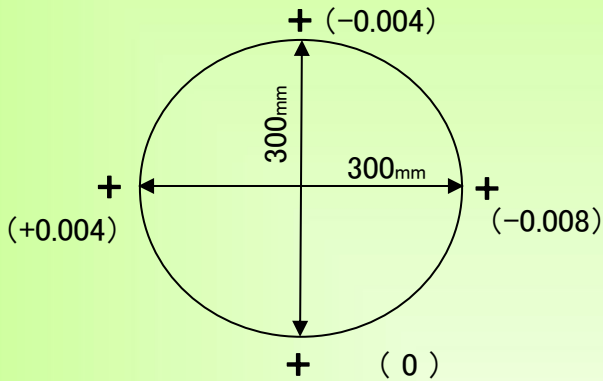

主軸振れ



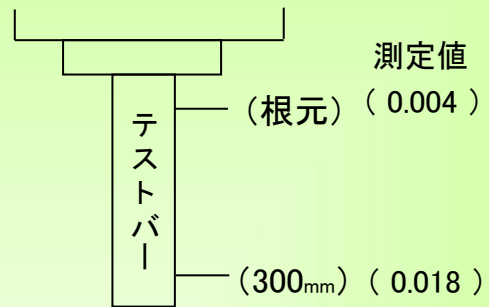


直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.020)

【XY】測定値 (0.002)

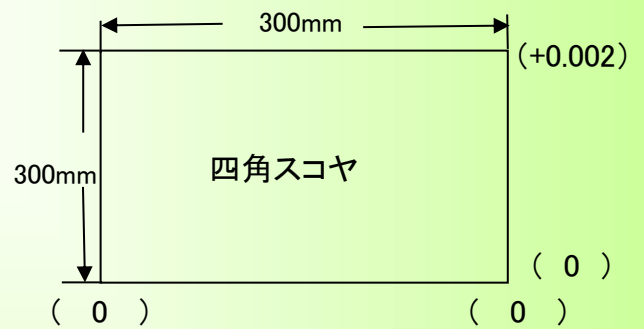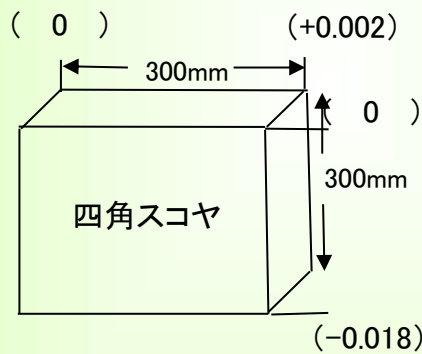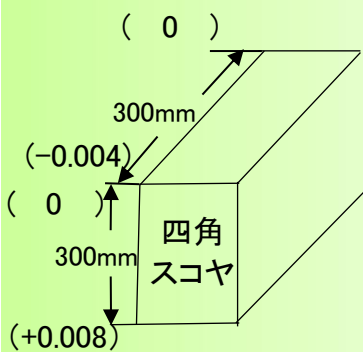

上面精度

※テーブルサイズ 1050×510

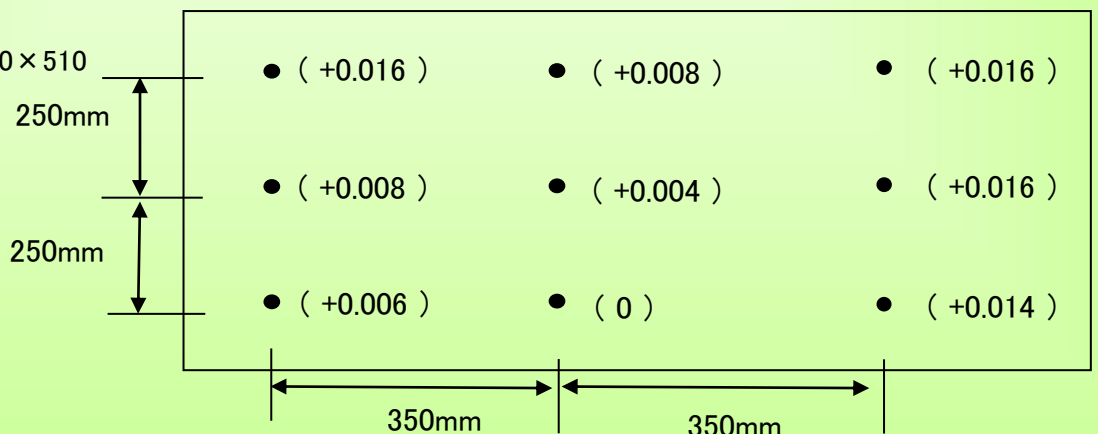

2025/2/28