


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2013.10	管理番号	P008808
型式	VM43R	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

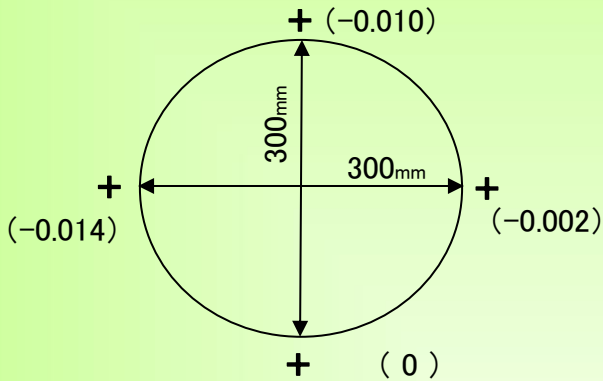

主軸振れ



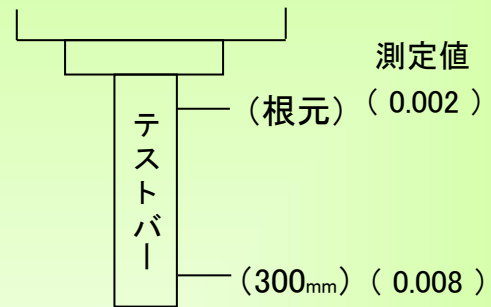


直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.016)

【XY】測定値 (0.004)

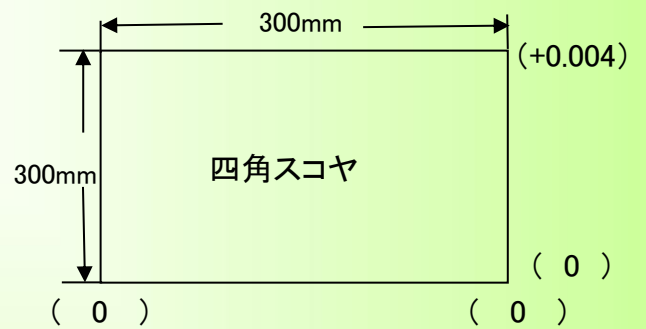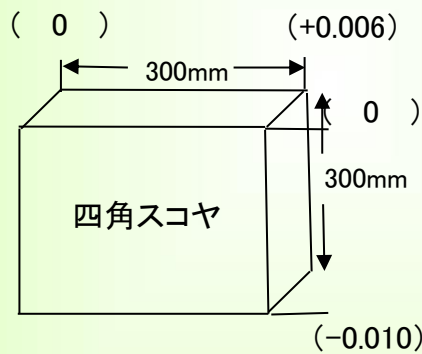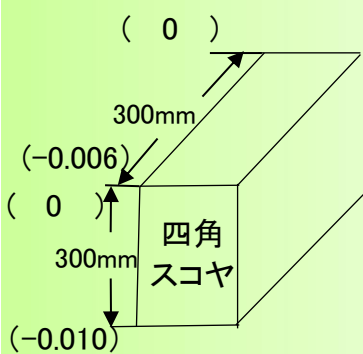

上面精度

※テーブルサイズ 800×420

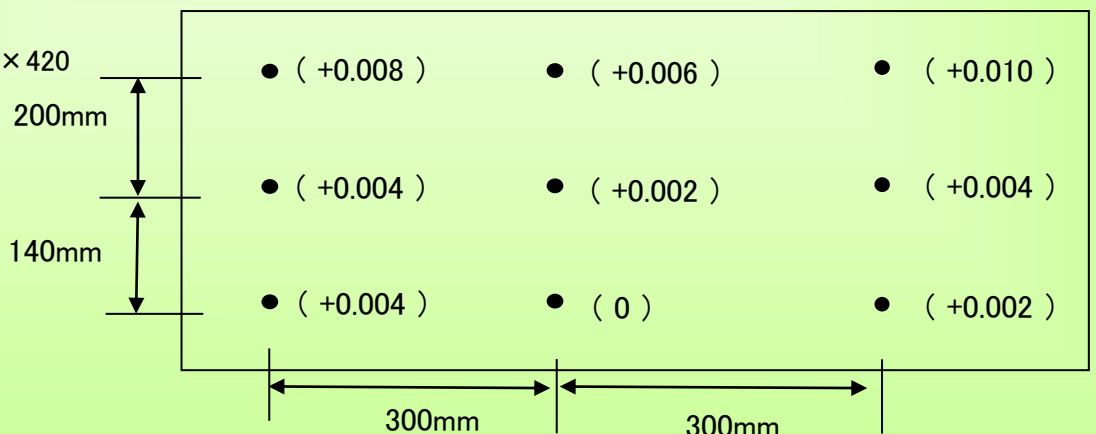

2025/1/24