


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2003	管理番号	P008806
型式	MILLAC-468V	測定者	野辺 沼	アシスタント	長谷川

振り回し(300ピッチ)

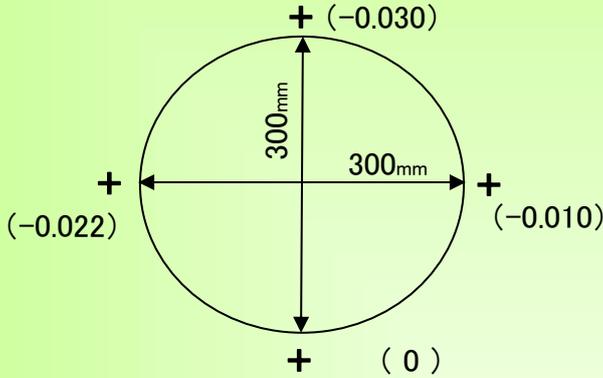

主軸振れ


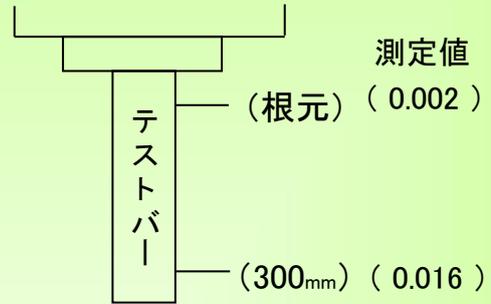


直角度

【YZ】測定値 (0.024)


【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.006)

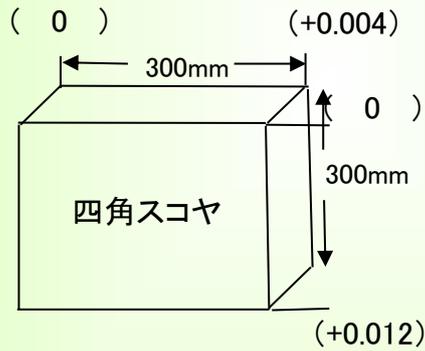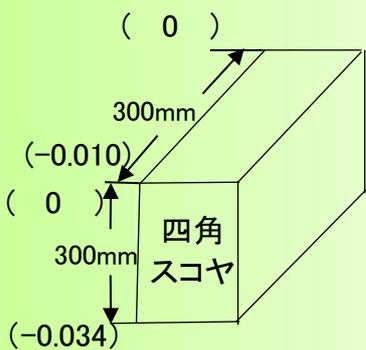

上面精度

※テーブルサイズ 1050×460

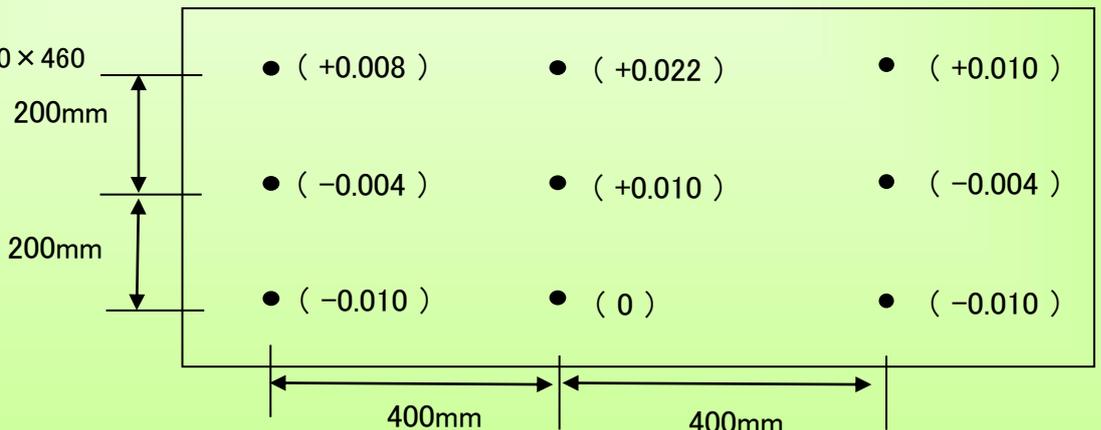

2024/1/29