


精度測定検査表


Examination for precision list

| | | | | | |
|------|----------|-----|------|--------|---------|
| メーカー | ヤマザキマザック | 年式 | 2005 | 管理番号 | P008583 |
| 型式 | VCN-410A | 測定者 | 武藤 | アシスタント | |

振り回し(300ピッチ)

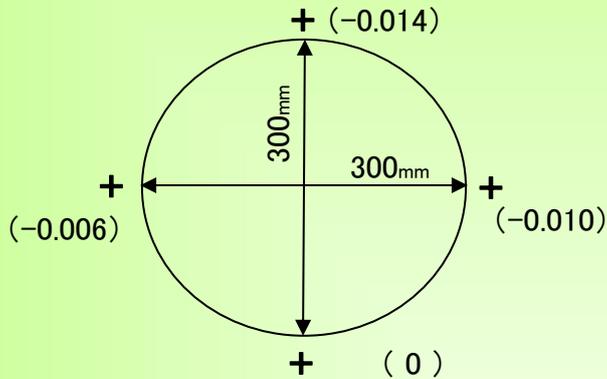

主軸振れ



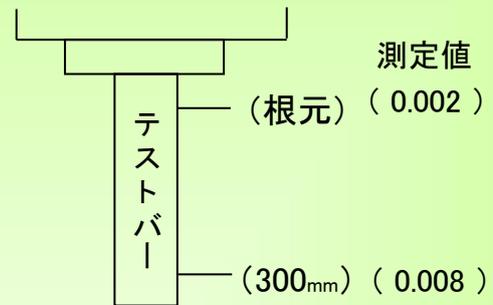


直角度

【YZ】測定値 (0.014)

【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.006)

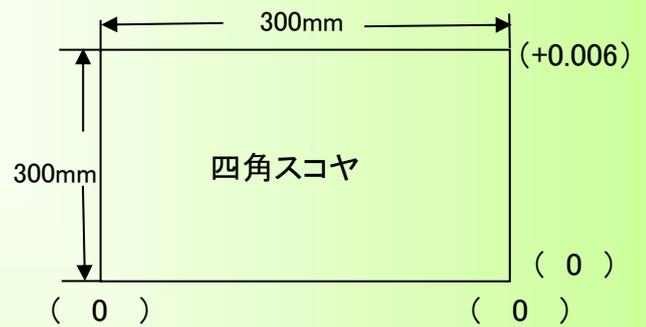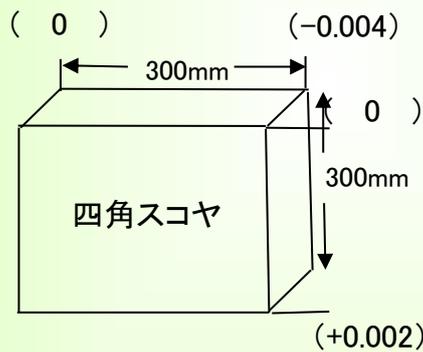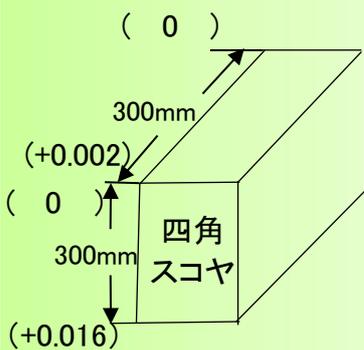

上面精度


※テーブルサイズ 410×900

【バックラッシュ測定】

X軸 0.002

Y軸 0.002

Z軸 0.002

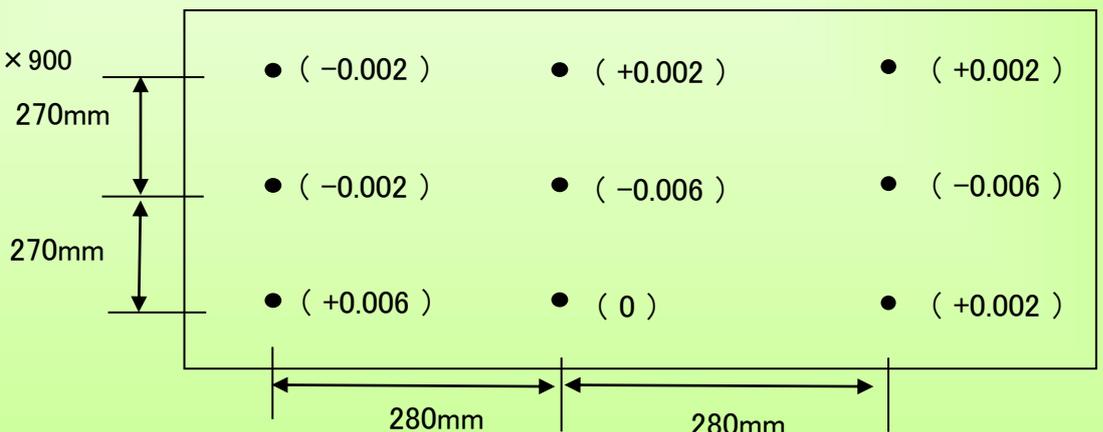

2025/2/28