


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	北村	年式	2014	管理番号	P008643
型式	Mycenter-HX400G	測定者	金子	アシスタント	

Z軸方向の平行度

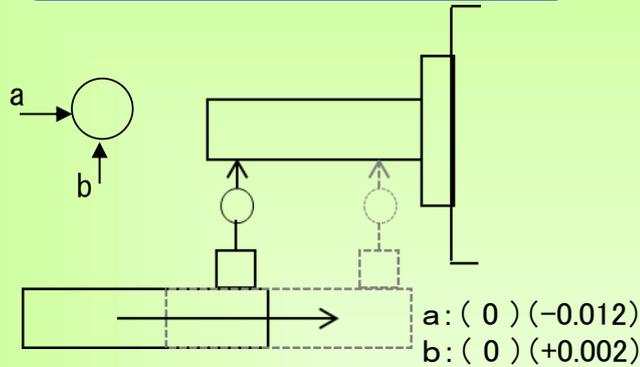

主軸振れ



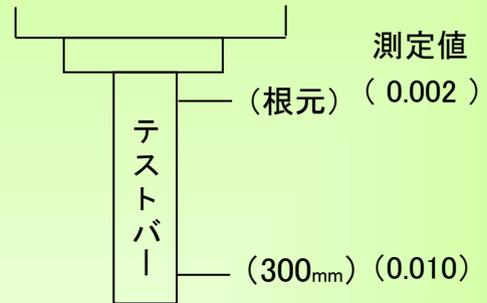


直角度

【XY】測定値 (0.008)


【ZY】測定値 (0.008)

【ZX】測定値 (0.006)

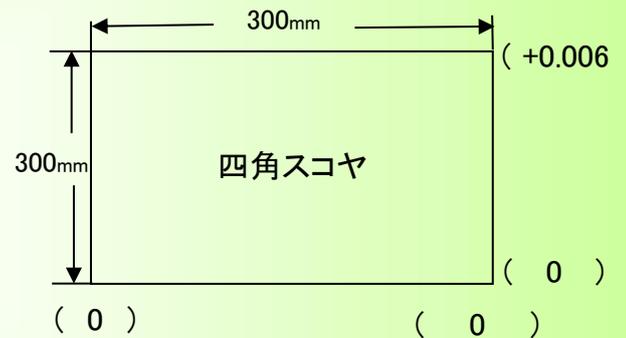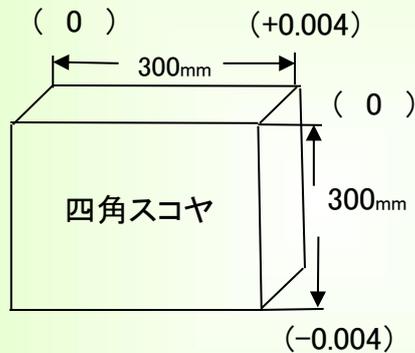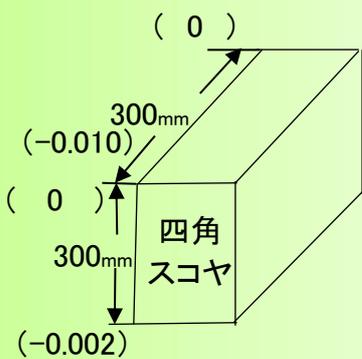

上面精度

テーブルサイズ: 400角
()パレット1
[—]パレット2

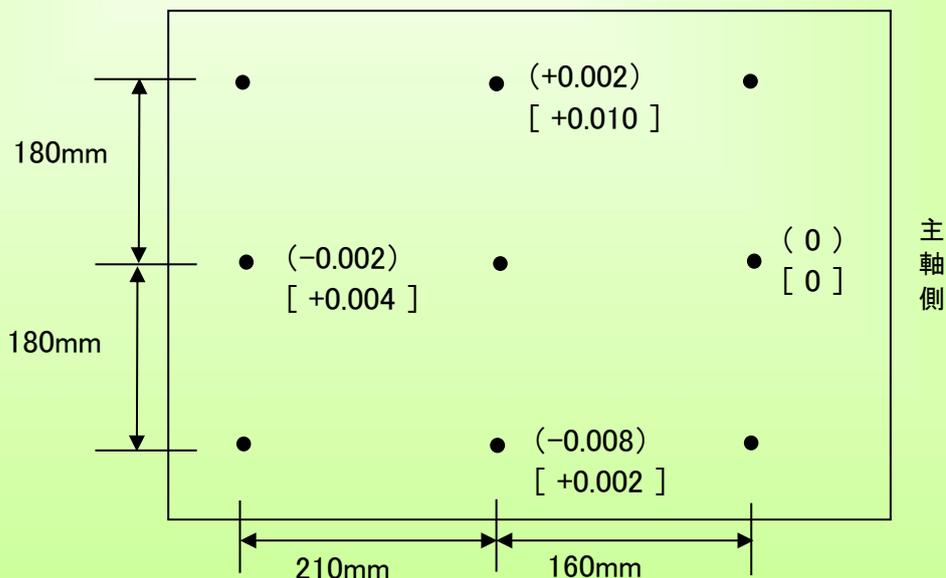

2024/9/5