


# 精度測定検査表


Examination for precision list

|      |                   |     |      |        |         |
|------|-------------------|-----|------|--------|---------|
| メーカー | ファナック             | 年式  | 2017 | 管理番号   | P008817 |
| 型式   | $\alpha$ -D14LiB5 | 測定者 | 金子   | アシスタント | 長谷川     |

## 振り回し(200ピッチ)

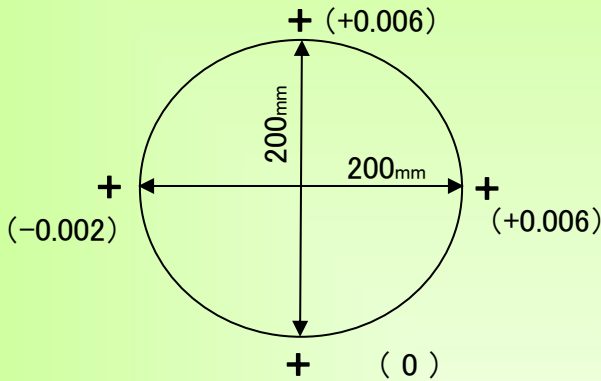

## 主軸振れ



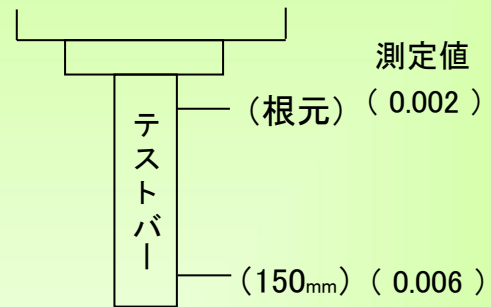


## 直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.004)

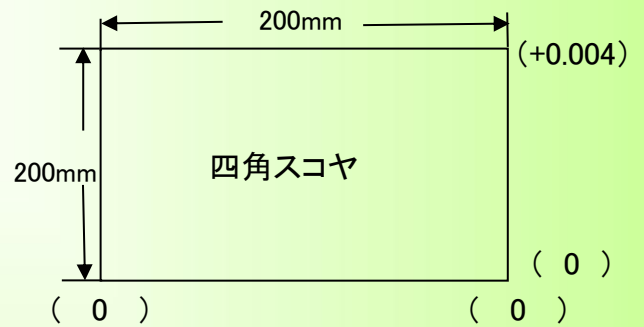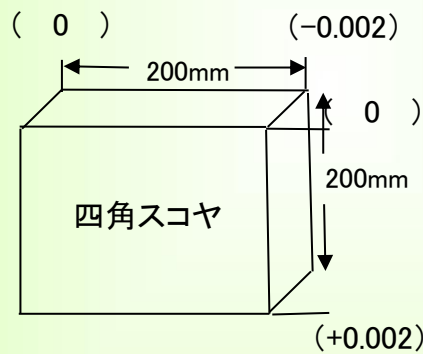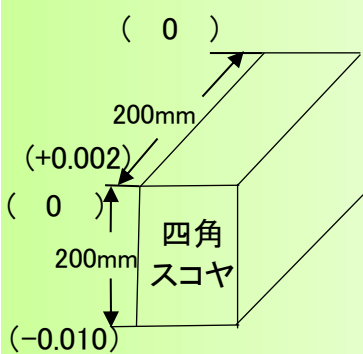

## 上面精度

※テーブルサイズ 850×410  
右側インデックス有

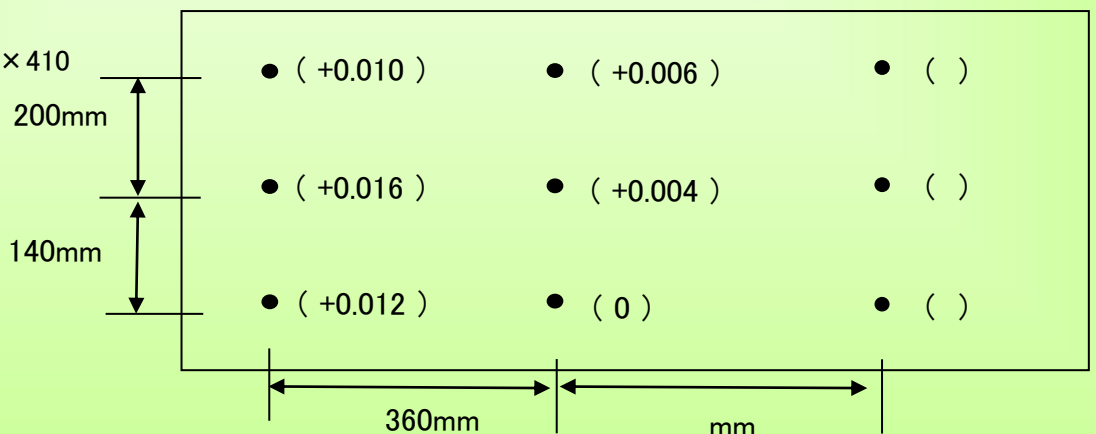

2025/3/3