


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2015	管理番号	P008840
型式	α -D21LiA5	測定者	長谷川	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

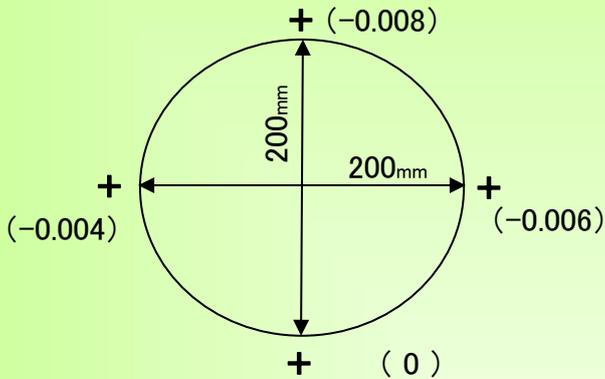

主軸振れ



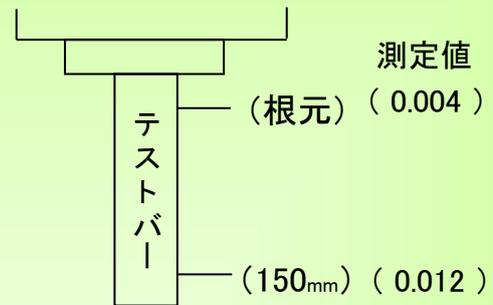


直角度

【YZ】測定値 (0.014)


【XZ】測定値 (0.002)

【XY】測定値 (0.002)

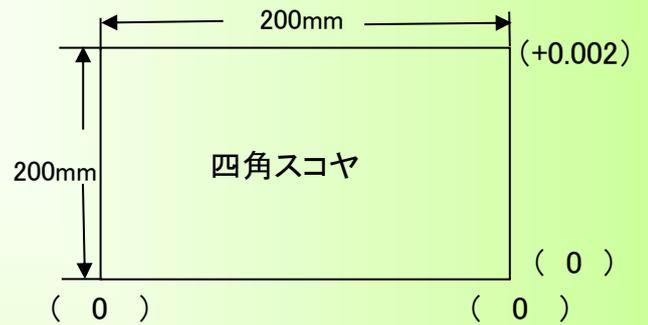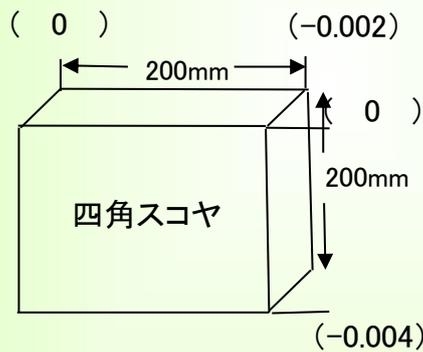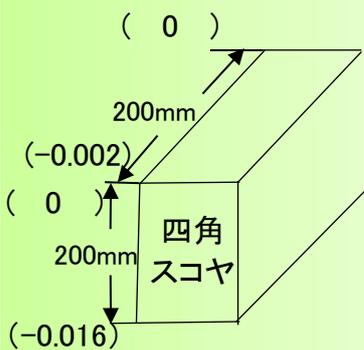

上面精度

※テーブルサイズ 850×410

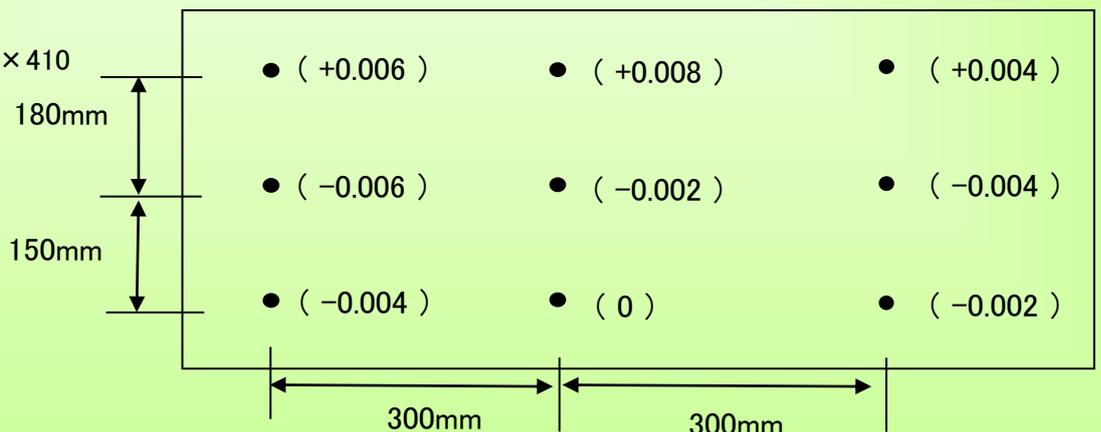

2025/3/3