


精度測定検査表


Examination for precision list

| | | | | | |
|------|-----------|-----|------|--------|---------|
| メーカー | 牧野フライス製作所 | 年式 | 2011 | 管理番号 | P008471 |
| 型式 | TC-R2B | 測定者 | | アシスタント | |

振り回し(200ピッチ)

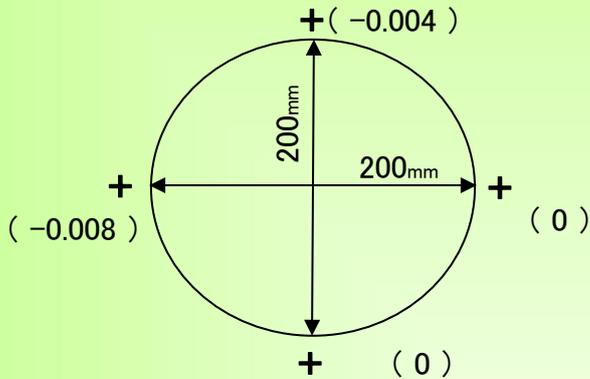

主軸振れ



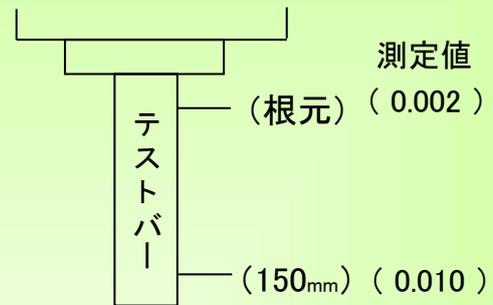


直角度

【YZ】測定値 (0.002)

【XZ】測定値 (0.002)

【XY】測定値 (0.008)

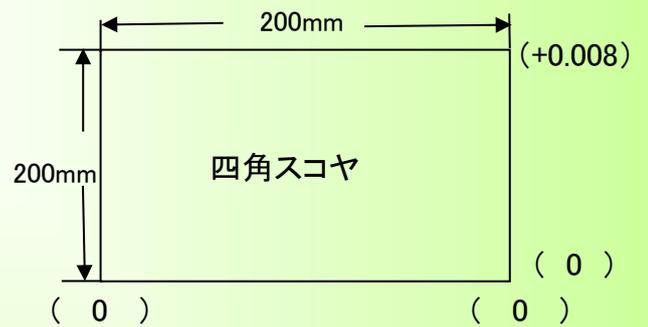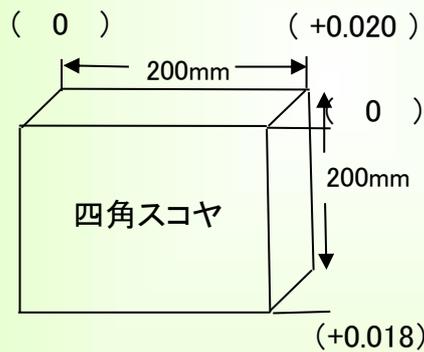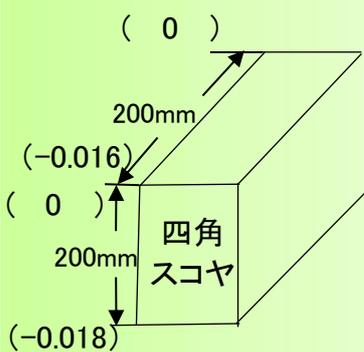

上面精度

※テーブルサイズ 600×300

No.1→ ()

No.2→ < >

