

# 精度測定検査表

Examination for precision list


測定日

2012.07.13


メーカー	日立精機	バーコード	P736
型式	VK45 II		

精度評価		コメント
A	0 ~ 0.02mm	根強い人気の日立精機。精度も全ての項目で良好です
<b>B</b>	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

## 振り回し(300ピッチ)

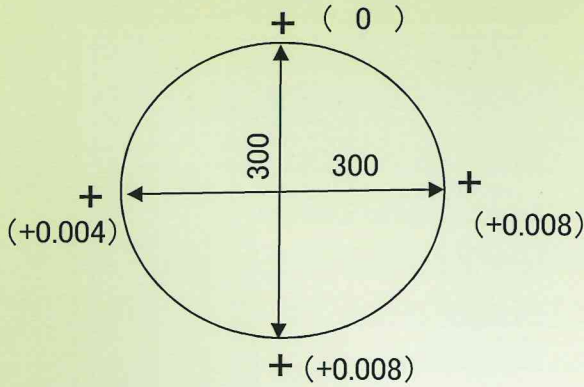


## 主軸振れ

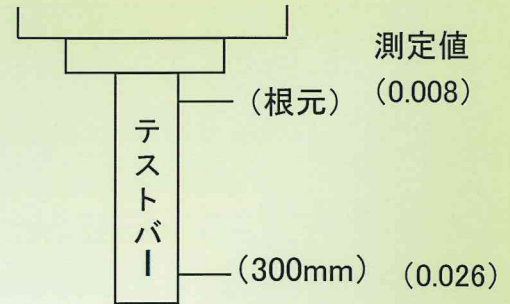


## 直角度


【Y Z】

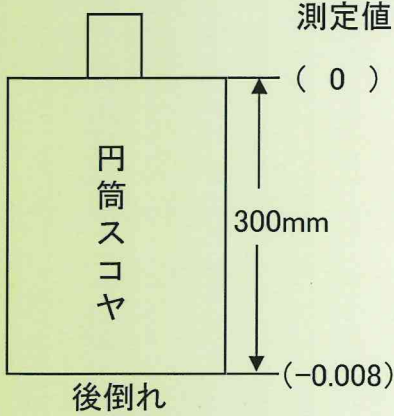

【X Z】

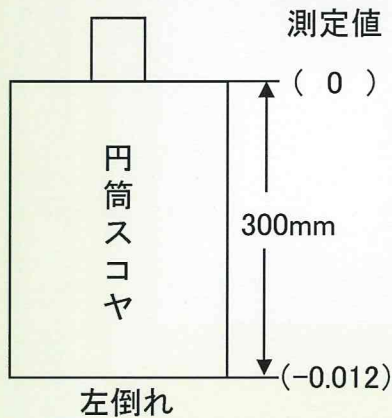

【X Y】

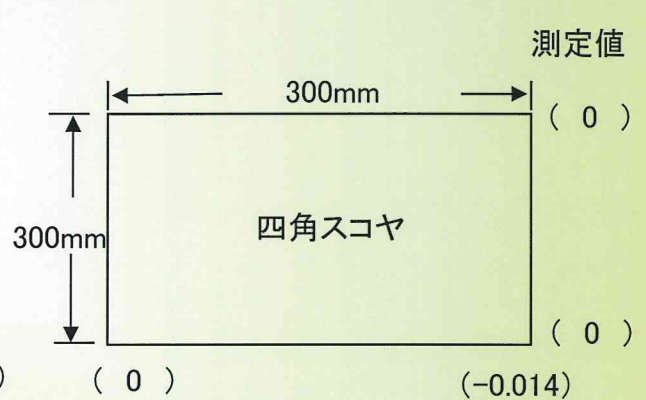

## 上面精度

